

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۶۵	۰,۳۷۶	۱۱,۹۸۴	۱۲,۳۶	۱۲,۷۳۶	۱۳,۱۱۲	۱۳,۴۸۸	۱۳,۸۶۴	۱۴,۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۱۳,۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۱۲,۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۳,۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۱۳,۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷

CV%: 1.528	SD: 0.199	Mean: 13.04
------------	-----------	-------------

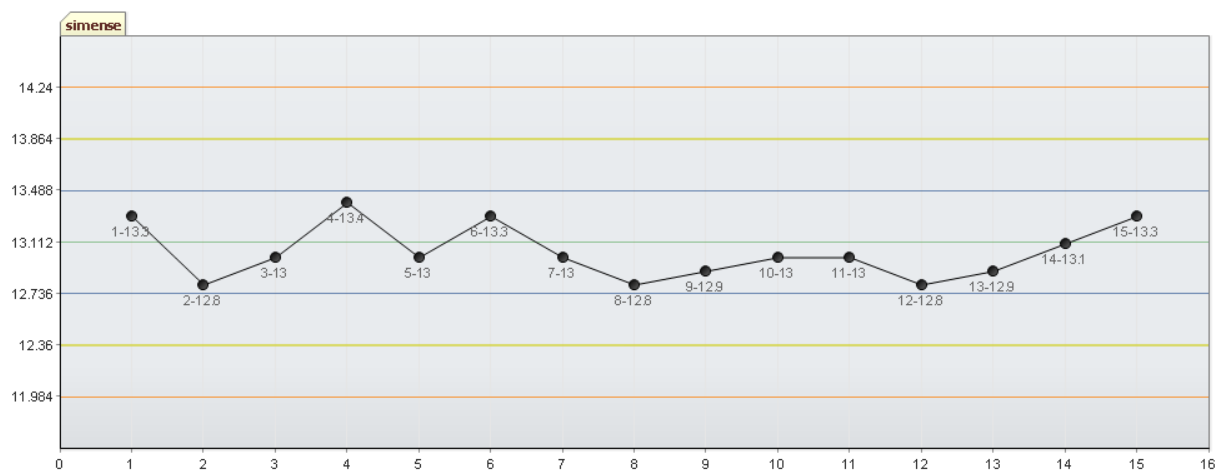

maternal control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۸: شروع کنترل : سری ساخت : MS۸۳۷۴ : Alpha Fetoprotein :
 عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۵۲	۱,۲۰۲	۵۲,۲۴۴	۵۳,۴۴۶	۵۴,۶۴۸	۵۵,۸۵	۵۷,۰۵۲	۵۸,۲۵۴	۵۹,۴۵۶

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳

CV%: 1.458	SD: 0.816	Mean: 56
------------	-----------	----------

