

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ec۲۱۸۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۷	۰,۴۲۴	۴۲,۴۱۱	۴۲,۸۳۵	۴۳,۲۵۹	۴۳,۶۸۳	۴۴,۱۰۷	۴۴,۵۳۱	۴۴,۹۵۵

مقدار	تاریخ
۴۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۴۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۴۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۴۳,۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۴۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰
۴۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۴۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۴۳,۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۴۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۴۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۴۴,۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶

CV%: 0.652	SD: 0.285	Mean: 43.7
------------	-----------	------------

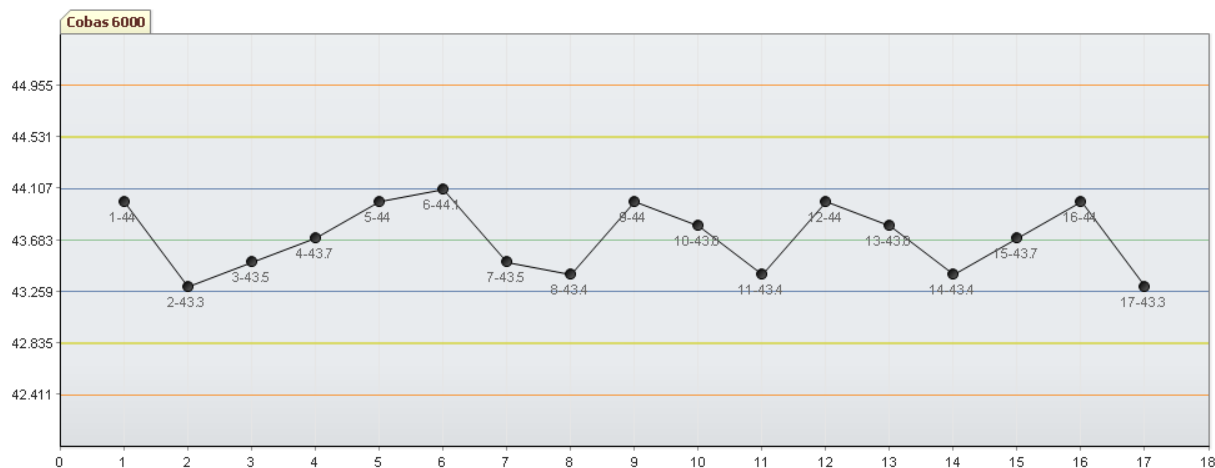

عنوان کنترل : abbott-3
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱	۷,۴	۸۹,۶	۹۷	۱۰۴,۴	۱۱۱,۸	۱۱۹,۲	۱۲۶,۶	۱۳۴

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳

CV%: 4.15	SD: 4.643	Mean: 111.875
-----------	-----------	---------------

