

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ec۲۱۸۰



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲,۹۳۳	۳۵,۴۰۱	۳۸,۳۳۴	۴۱,۲۶۷	۴۴,۲	۴۷,۱۳۳	۵۰,۰۶۶	۵۲,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۴۲,۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۴۲,۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۴۴,۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۴۳,۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۴۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۴۱,۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۴۴,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۶,۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۴۳,۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۴۳,۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۴۳,۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۴۵,۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۴۳,۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۴۱,۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۴۱,۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵

CV%: 3.744	SD: 1.637	Mean: 43.711
------------	-----------	--------------

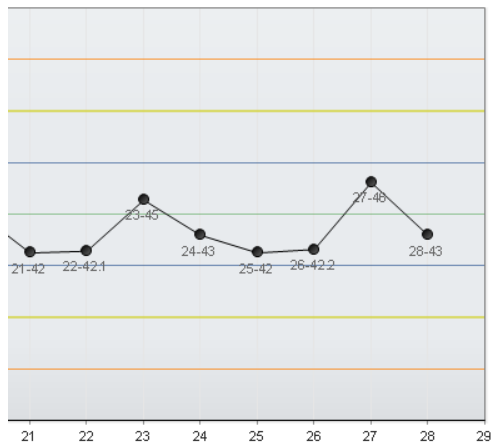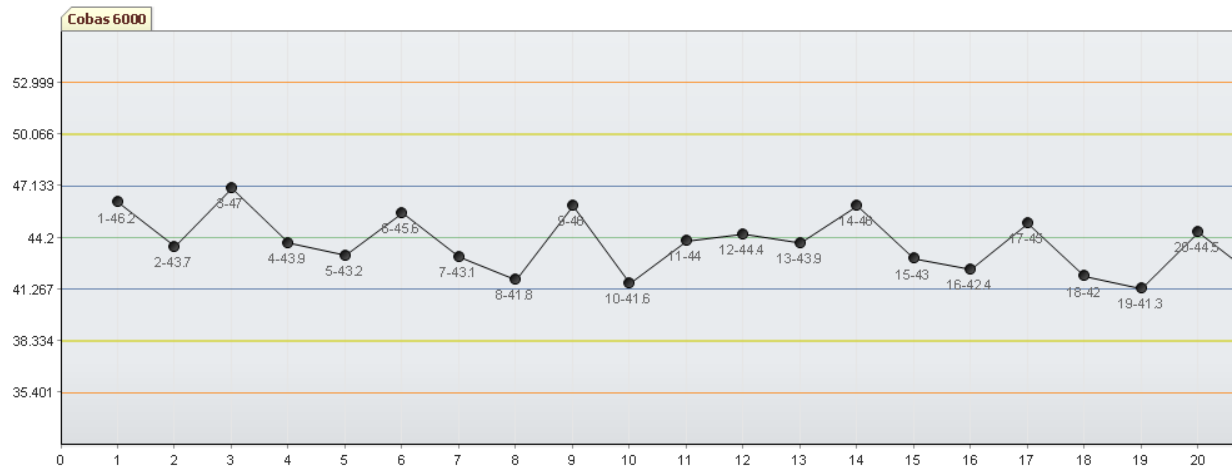

عنوان کنترل : Tumor Marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : ۶۷۱۱۴۶۹۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۱	۰,۹۸۷	۱۹,۴۱۴	۲۰,۴۰۱	۲۱,۳۸۸	۲۲,۳۷۵	۲۳,۳۶۲	۲۴,۳۴۹	۲۵,۳۳۶

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱

CV%: 2.547	SD: 0.577	Mean: 22.667
------------	-----------	--------------

