

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

سری ساخت : //۳۴۳۱۳۳۰۱

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴	۶.۶	۴۶.۲	۵۲.۸	۵۹.۴	۶۶	۷۲.۶	۷۹.۲	۸۵.۸

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 8.778	SD: 6.161	Mean: 70.19
------------	-----------	-------------

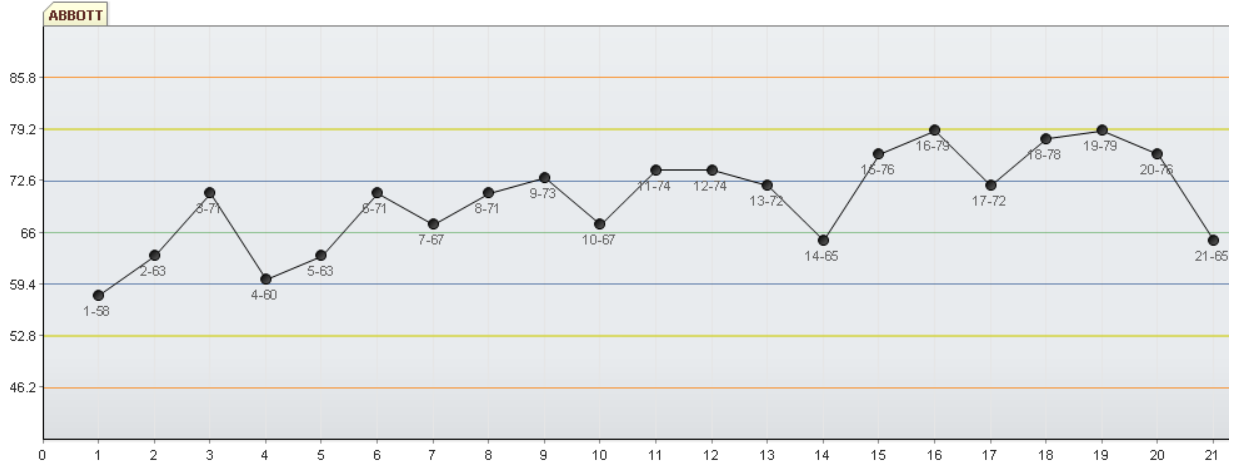

22