


عنوان آزمایش : Free T3  
 عنوان دستگاه : e411  
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high  
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲  
 سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳	۰.۹۶۷	۱۳.۱۹۹	۱۴.۱۶۶	۱۵.۱۳۳	۱۶.۱	۱۷.۰۶۷	۱۸.۰۳۴	۱۹.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۷.۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۴.۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۶.۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۵.۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴

CV%: 7.435	SD: 1.188	Mean: 15.973
------------	-----------	--------------

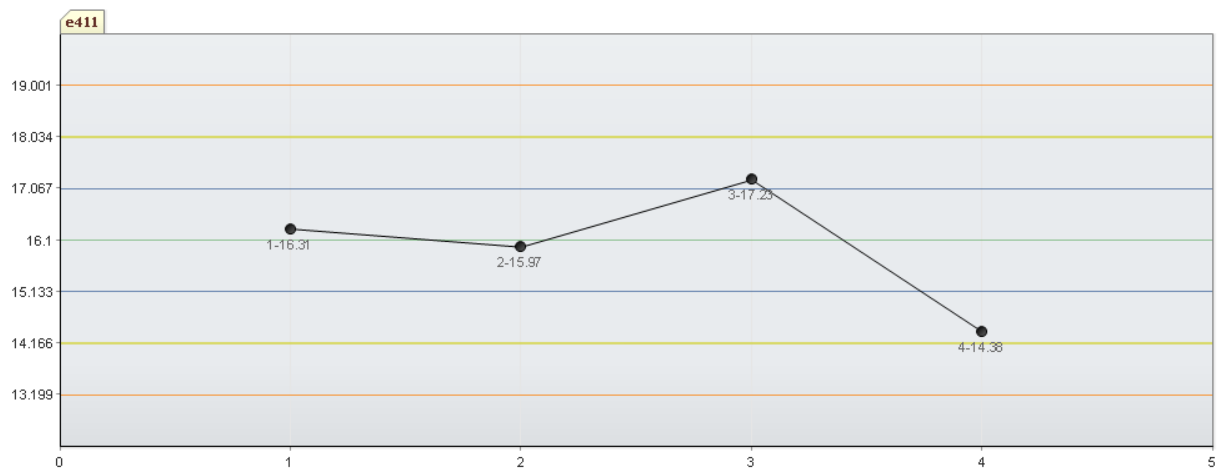

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : e411  
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰  
عنوان کنترل : universal low  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳	۰.۲۳۷	۳.۲۳۹	۳.۴۷۶	۳.۹۵	۴.۱۸۷	۴.۴۲۴	۴.۶۶۱

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۳.۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۳.۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۴.۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۳.۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۳.۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۳.۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۳.۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۳.۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳.۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳.۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳.۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳.۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲

CV%: 6.976	SD: 0.265	Mean: 3.802
------------	-----------	-------------

