

عنوان کنترل : abbott I

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : Free T3

عنوان دستگاه : Abbott


%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۰	۰.۳۱۸	۲.۳۴۱	۲.۵۵۹	۲.۸۷۷	۳.۱۹۵	۳.۵۱۳	۳.۸۳۱	۴.۱۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳.۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳.۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳.۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۳.۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۳.۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۳.۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳.۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹

CV%: 3.917	SD: 0.131	Mean: 3.348
------------	-----------	-------------

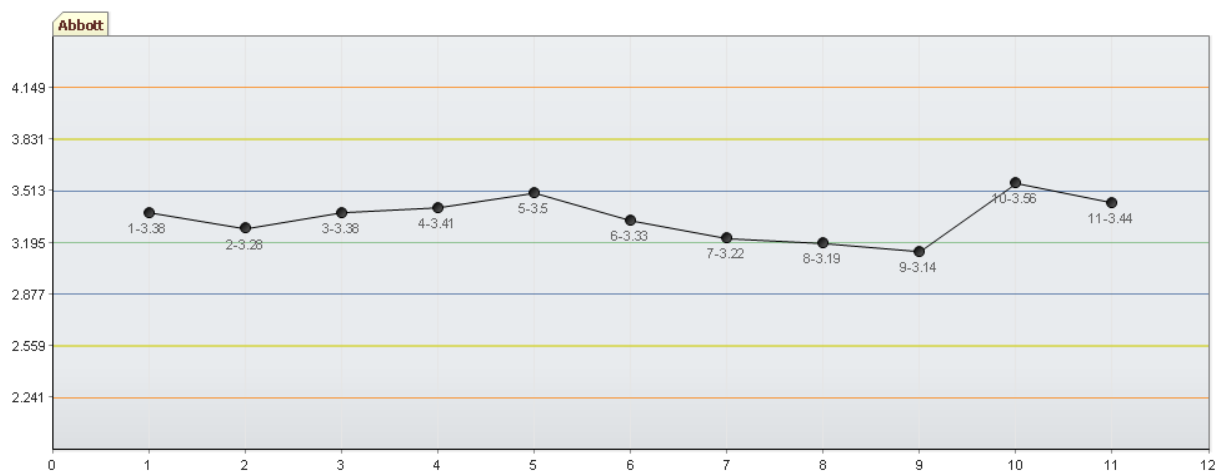

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳	۰.۸۶۷	۱۱.۶۹۹	۱۲.۵۶۶	۱۳.۴۳۳	۱۴.۳	۱۵.۱۶۷	۱۶.۰۳۴	۱۶.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۵.۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۴.۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

CV%: 4.251	SD: 0.625	Mean: 14.706
------------	-----------	--------------

