

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۶/۰۶:

سری ساخت : //BE00۱۰۴۳۴

HBcAb (Total:
(IgG/M/A

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۵	۰.۴۱	۱.۵	۱.۹۱	۲.۳۲	۲.۷۳	۳.۱۴	۳.۵۵	۳.۹۶

مقدار	تاریخ
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۴
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۷
۲.۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۸
۲.۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۹
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲.۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲.۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۲.۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲.۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲.۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲.۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲.۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴

CV%: 4.782	SD: 0.121	Mean: 2.54
------------	-----------	------------

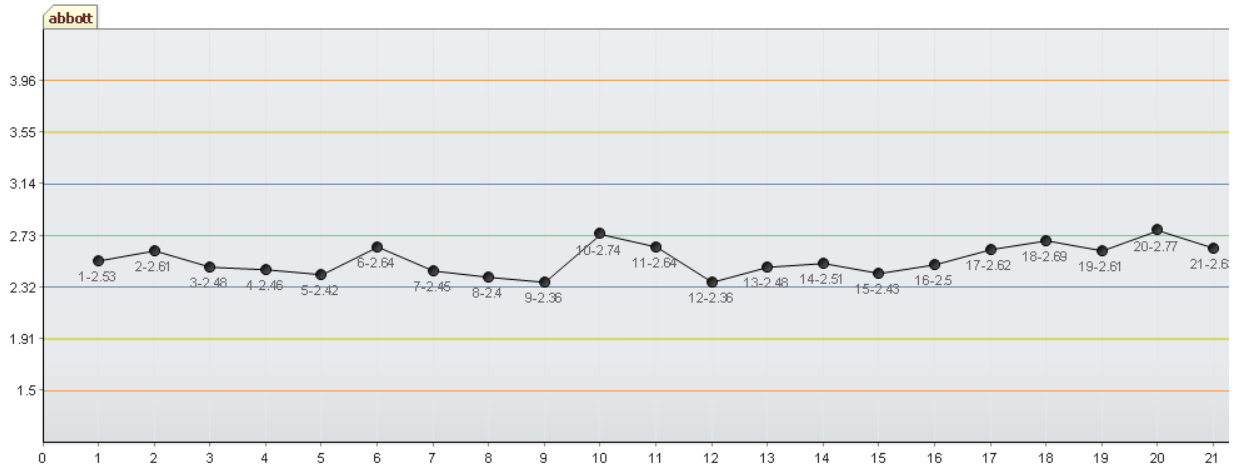

22