

عنوان کنترل : ctI M
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : K41023۸۸


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۱۷,۵	۱۲۲,۵	۱۴۰	۱۵۷,۵	۱۷۵	۱۹۲,۵	۲۱۰	۲۲۷,۵

مقدار	تاریخ
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۷۵,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۶۶,۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸

CV%: 7.431	SD: 12.751	Mean: 171.6
------------	------------	-------------

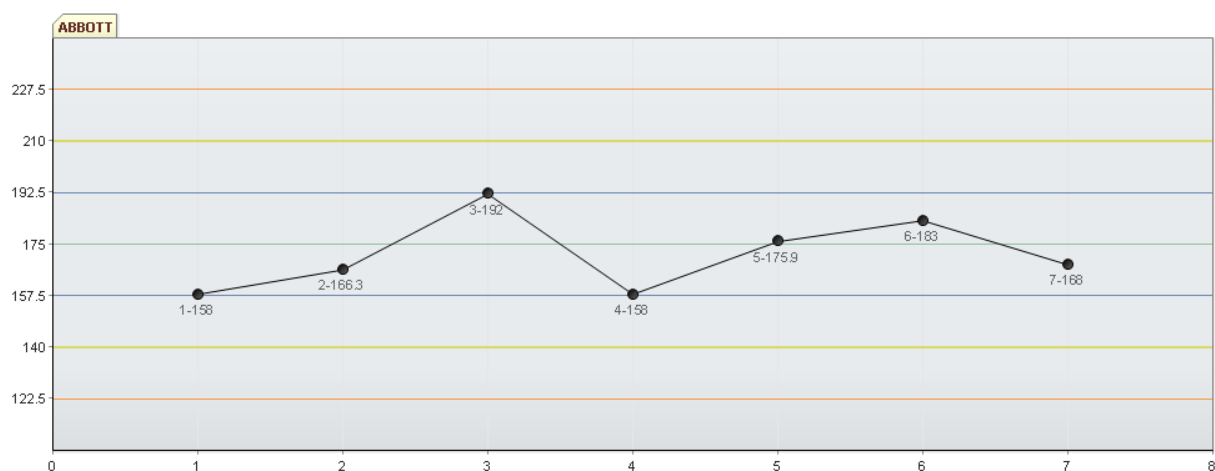

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲	۴,۰۶۷	۳۲,۸۹۹	۳۶,۹۶۶	۴۱,۰۳۳	۴۵,۱	۴۹,۱۶۷	۵۳,۲۳۴	۵۷,۳۰۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۴۹,۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴

CV%: 5.693	SD: 2.595	Mean: 45.586
------------	-----------	--------------

