

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

سری ساخت : ۱۰۴۰۴۵۰

IGF-1 : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۴	۴.۳	۴۰.۸	۴۵.۱	۴۹.۴	۵۳.۷	۵۸	۶۲.۳	۶۶.۶

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 6.635	SD: 3.79	Mean: 57.111
------------	----------	--------------

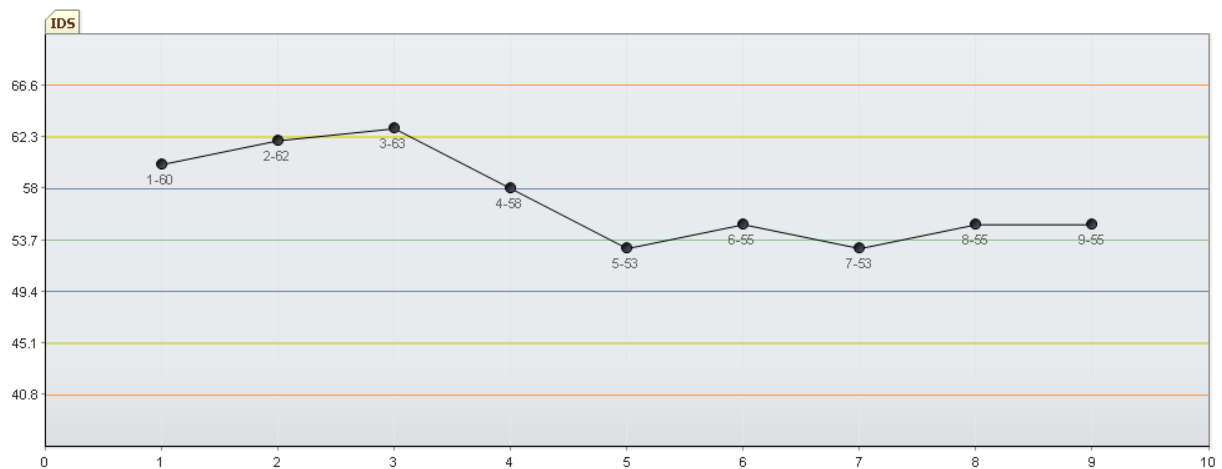

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

سری ساخت : ۱۰۴۰۴۵۰

IGF-1 : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴	۱۶	۱۵۲.۲	۱۶۸.۲	۱۸۴.۲	۲۰۰.۲	۲۱۶.۲	۲۳۲.۲	۲۴۸.۲

مقدار	تاریخ
۱۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۱۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۲۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰

CV%: 9.327	SD: 19.816	Mean: 212.462
------------	------------	---------------

