

عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemens


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۶۹۷	۱۶.۸۱۱	۳۰۷.۵	۳۳۴.۳۱۱	۳۴۱.۱۲۲	۳۵۷.۹۳۳	۳۷۴.۷۴۴	۳۹۱.۵۵۵	۴۰۸.۳۶۶

مقدار	تاریخ
۳۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۳۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۳۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲

CV%: 4.33	SD: 15.561	Mean: 359.381
-----------	------------	---------------

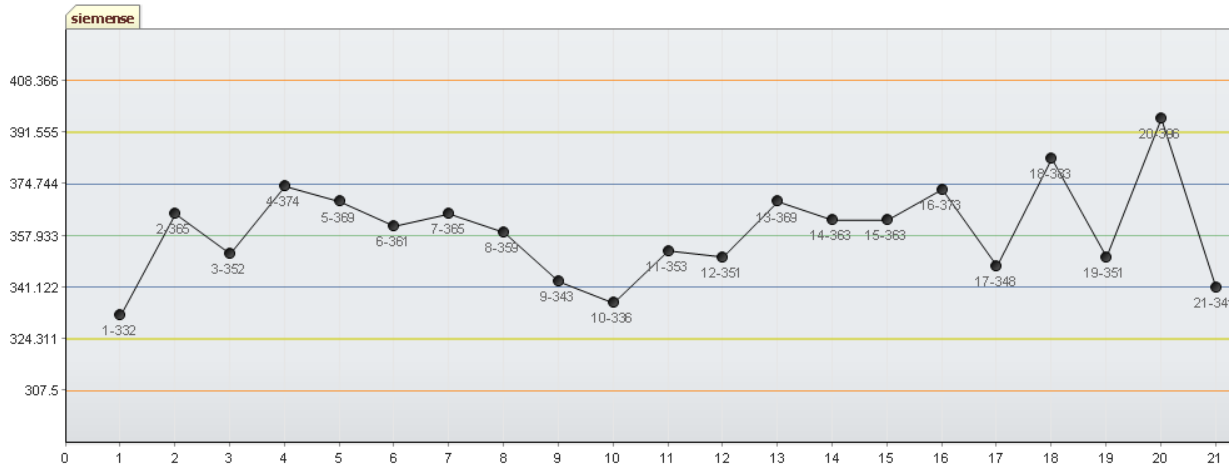

22