

عنوان کنترل : biorad I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۱/۱۹:

سری ساخت : ۴۰۴۲۱

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : simense



%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۸.۶	۷.۵۶۷	۴۰.۷۹۹	۴۸.۳۶۶	۵۵.۹۳۳	۶۳.۵	۷۱.۰۶۷	۷۸.۶۳۴	۸۶.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۶۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۶۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۶۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۶۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۶۹.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
۷۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۶۰.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۷۰.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۶۷.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
۶۵.۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

CV%: 4.016	SD: 2.629	Mean: 65.458
------------	-----------	--------------

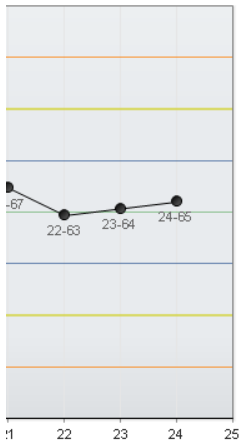

عنوان کنترل : prmium plus II

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۶	۱۷	۱۵۴	۱۷۱	۱۸۸	۲۰۵	۲۲۲	۲۳۹	۲۵۶

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۱۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

CV%: 4.356	SD: 9.024	Mean: 207.167
------------	-----------	---------------

