

عنوان کنترل : biorad I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۱/۱۹:

سری ساخت : ۴۰۴۲۱

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : simense



%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۰.۴۶۷	۳.۱۹۹	۳.۶۶۶	۴.۱۳۳	۴.۶	۵.۰۶۷	۵.۵۳۴	۶.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴.۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۴.۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۴.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۴.۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
۴.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴.۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۵.۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹

CV%: 9.064	SD: 0.419	Mean: 4.625
------------	-----------	-------------

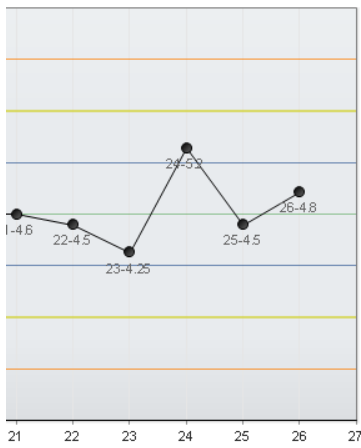

عنوان کنترل : permium plus II  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4  
عنوان دستگاه : simesne  
سری ساخت : EC۲۱۰۷

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۰.۷۱۷	۶.۴۹۹	۷.۲۱۶	۷.۹۳۳	۸.۶۵	۹.۳۶۷	۱۰.۰۸۴	۱۰.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۸.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۸.۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۸.۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۸.۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۸.۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۸.۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۸.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۷.۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

CV%: 5.173	SD: 0.441	Mean: 8.525
------------	-----------	-------------

