

عنوان کنترل : biorad I
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۴۰۴۲۱


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۵	۰.۰۳۲	۰.۳۴۷	۰.۳۷۹	۰.۴۱۱	۰.۴۴۳	۰.۴۷۵	۰.۵۰۷	۰.۵۳۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۰.۳۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۰.۳۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۳۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۴۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۰.۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۴۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴

CV%: 6.227	SD: 0.026	Mean: 0.413
------------	-----------	-------------

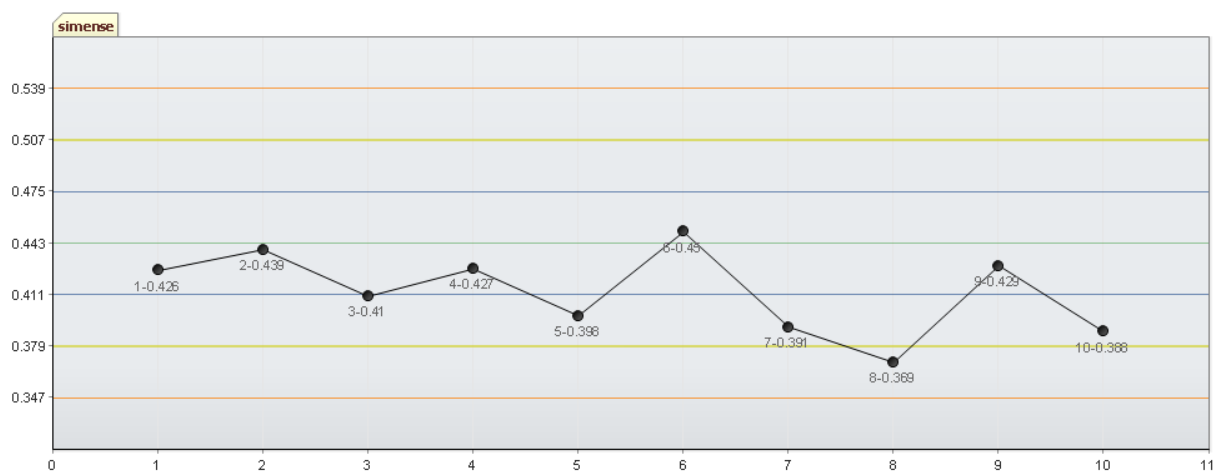

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : ۴۰۳۸۳-/-/۴۰
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۹.۵	۲.۹۱۷	۲۳.۹۹۹	۲۶.۹۱۶	۳۲.۷۵	۳۵.۶۶۷	۳۸.۵۸۴	۴۱.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۳۰.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳۱.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۴.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۹.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۳.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۰.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۸.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۷.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۳۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۰.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۰.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۸.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

CV%: 7.66	SD: 2.396	Mean: 31.281
-----------	-----------	--------------

