

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۱/۱۸:

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۱۹۱۶۲


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۹	۲۶	۱۸۲	۲۰۸	۲۳۴	۲۶۰	۲۸۶	۳۱۲	۳۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱۷.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۲۴۸.۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲۳۹.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۶۰.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲۳۶.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۳۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۲۱.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۳۵.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲۳۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۲۴۶.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۳۹.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲
۲۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲۴۱.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲۴۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷

CV%: 4.917	SD: 11.827	Mean: 240.524
------------	------------	---------------

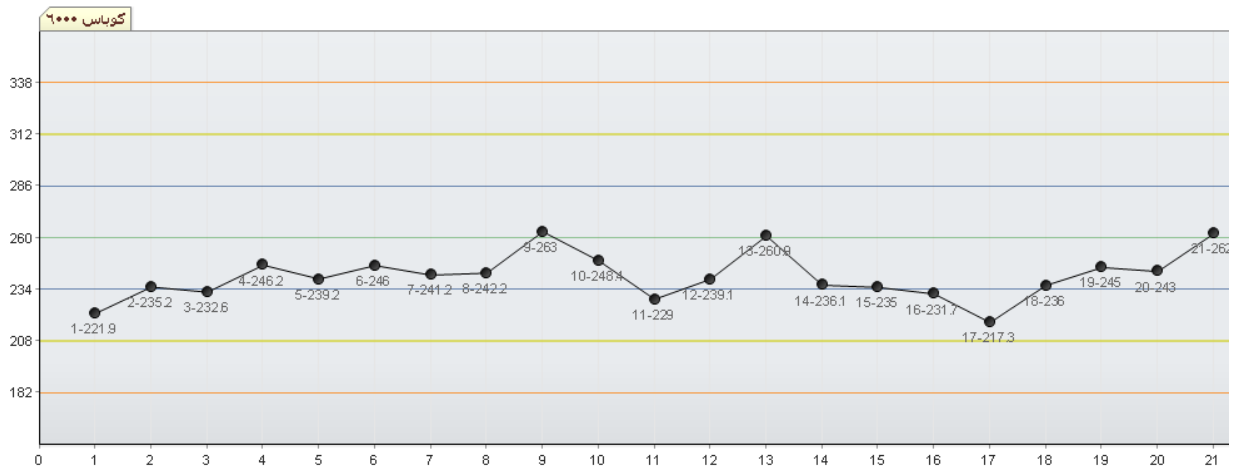

22