

Diasorin I : عنوان کنترل : شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴  
 Thyroglobulin : عنوان آزمایش : سری ساخت : ۴۴۱۱۰۹  
 Liaison : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۷	۰.۳۷۳	۲.۳۶۱	۲.۷۳۴	۳.۱۰۷	۳.۴۸	۲.۸۵۳	۴.۲۲۶	۴.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۳.۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴.۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۳.۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۳.۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳.۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳.۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲

مقدار	تاریخ
۳.۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳.۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

CV%: 7.938	SD: 0.288	Mean: 3.626
------------	-----------	-------------

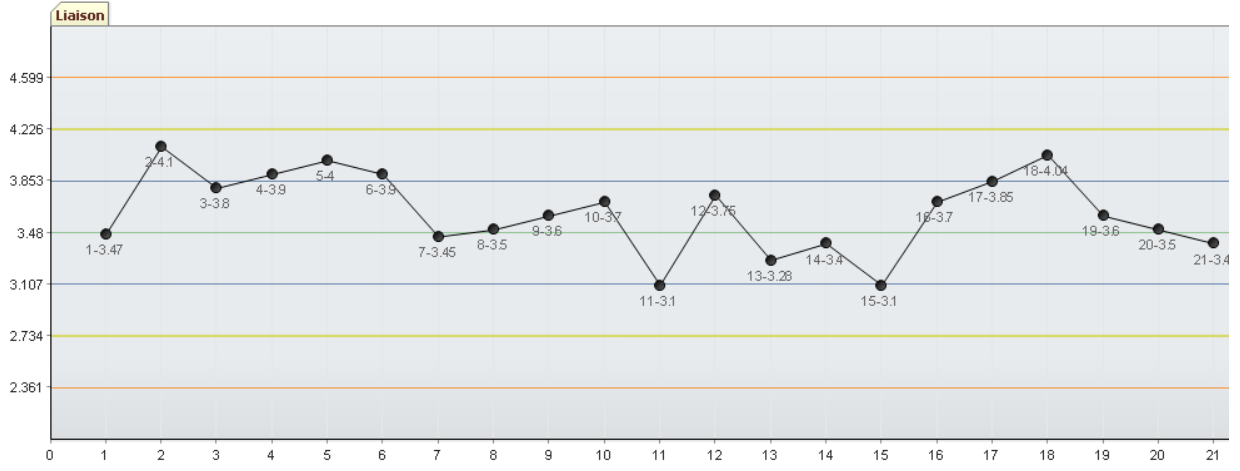

22

عنوان کنترل : universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۴/۰۱:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲-

عنوان آزمایش : Thyroglobulin  
عنوان دستگاه : COBAS 6000

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۷	۱.۹	۱۵.۵	۱۷.۴	۲۱.۲	۲۳.۱	۲۵	۲۶.۹

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

CV%: 11.503	SD: 2.646	Mean: 23
-------------	-----------	----------

