

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

سری ساخت: ۷۵۴۶۶۲

(Acid phosphatase (total : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۲۲	۰,۵۴۹	۲۳,۰۴۷	۲۳,۵۹۶	۲۴,۱۴۵	۲۴,۶۹۴	۲۵,۲۴۳	۲۵,۷۹۲	۲۶,۳۴۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۴,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲۴,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۴,۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۲۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۲۴,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۵,۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۴,۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۲۵,۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۲۴,۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹

CV%: 1.775	SD: 0.435	Mean: 24.515
------------	-----------	--------------

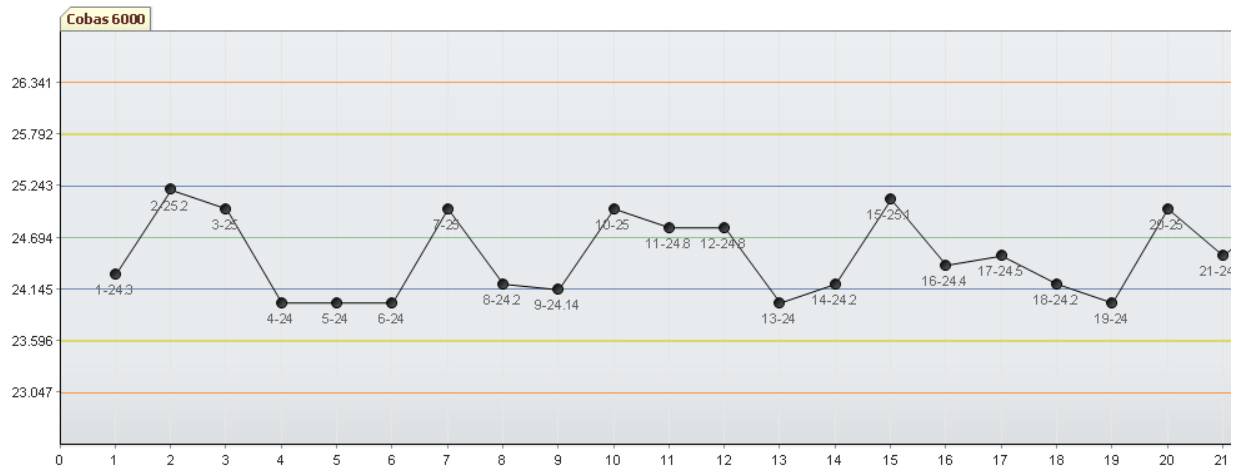

Multi 1 : عنوان کنترل : شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
 (Acid phosphatase (total : عنوان آزمایش : عنوان دستگاه :
 کوباس اینتگرا ۴۰۰ : کوباس اینتگرا ۴۰۰ : سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۷۳	۰,۶۸۶	۲۱,۸۲۵	۲۲,۵۱۱	۲۳,۱۹۷	۲۳,۸۸۳	۲۴,۵۶۹	۲۵,۲۵۵	۲۵,۹۴۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

CV%: 0.882	SD: 0.212	Mean: 24.05
------------	-----------	-------------

