

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۳۱	۱۳,۴	۲۵۹	۲۷۲,۴	۲۸۵,۸	۲۹۹,۲	۳۱۲,۶	۳۲۶	۳۳۹,۴

مقدار	تاریخ
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 3.984	SD: 11.884	Mean: 298.273
------------	------------	---------------

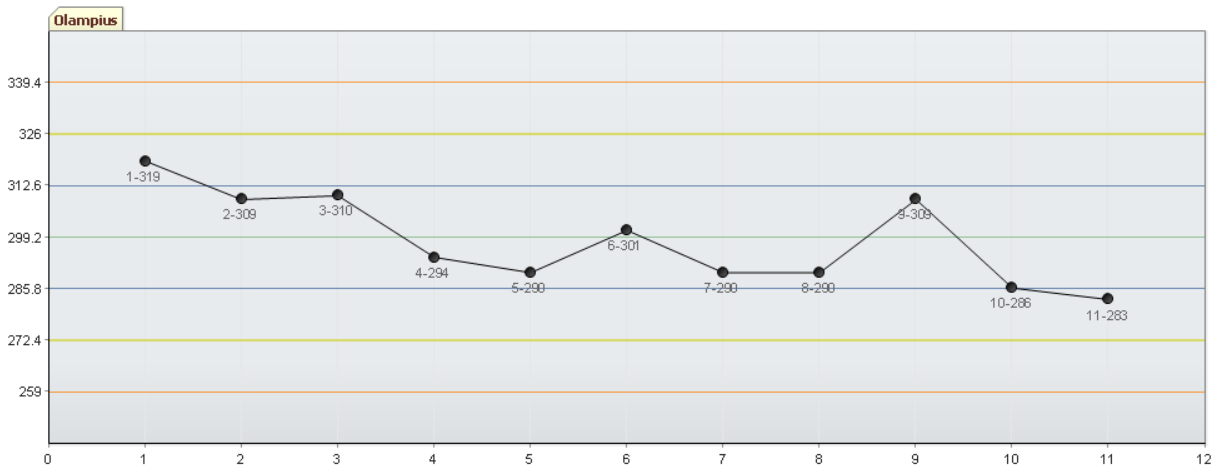

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۹,۳۳۳	۱۱۲,۰۰۱	۱۲۱,۳۳۴	۱۳۰,۶۶۷	۱۴۰	۱۴۹,۳۳۳	۱۵۸,۶۶۶	۱۶۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲

CV%: 1.239	SD: 1.75	Mean: 141.308
------------	----------	---------------

