

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۷۹۰۴۲۳۰


| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۷۸۸ | ۰,۰۱۳ | ۰,۴۴۴ | ۰,۴۵۷ | ۰,۴۷ | ۰,۴۸۳ | ۰,۴۹۶ | ۰,۵۰۹ | ۰,۵۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
| ۰,۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
| ۰,۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
| ۰,۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
| ۰,۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
| ۰,۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰,۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
| ۰,۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
| ۰,۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| ۰,۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
| ۰,۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 1.616 | SD: 0.008 | Mean: 0.482 |
|------------|-----------|-------------|

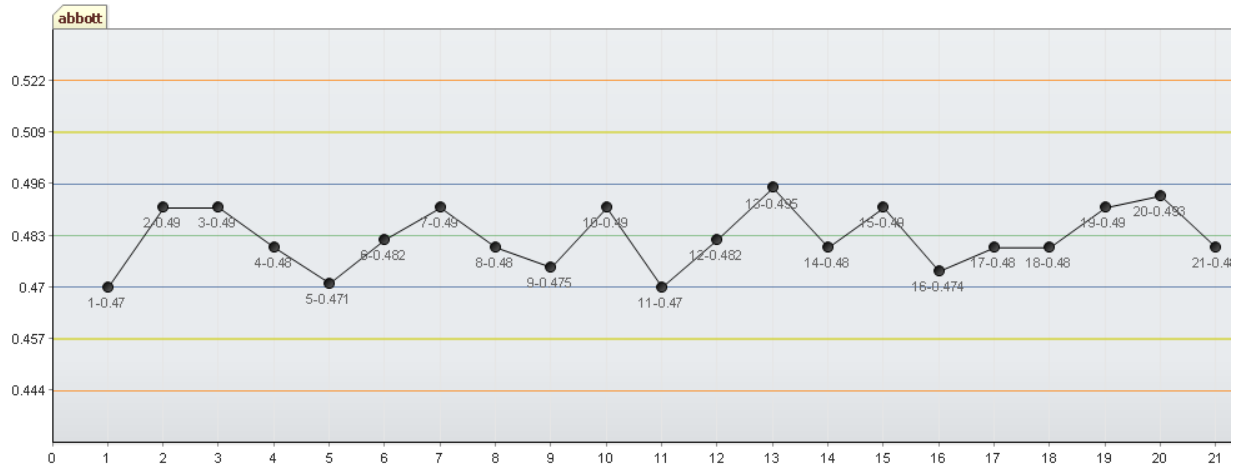

22