

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۷۹۰۴۲۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۷	۰,۰۲۷	۰,۲۶۶	۰,۲۹۳	۰,۳۲	۰,۳۴۷	۰,۳۷۴	۰,۴۰۱	۰,۴۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۰,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۰,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۰,۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۰,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰,۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 4.464	SD: 0.015	Mean: 0.344
------------	-----------	-------------

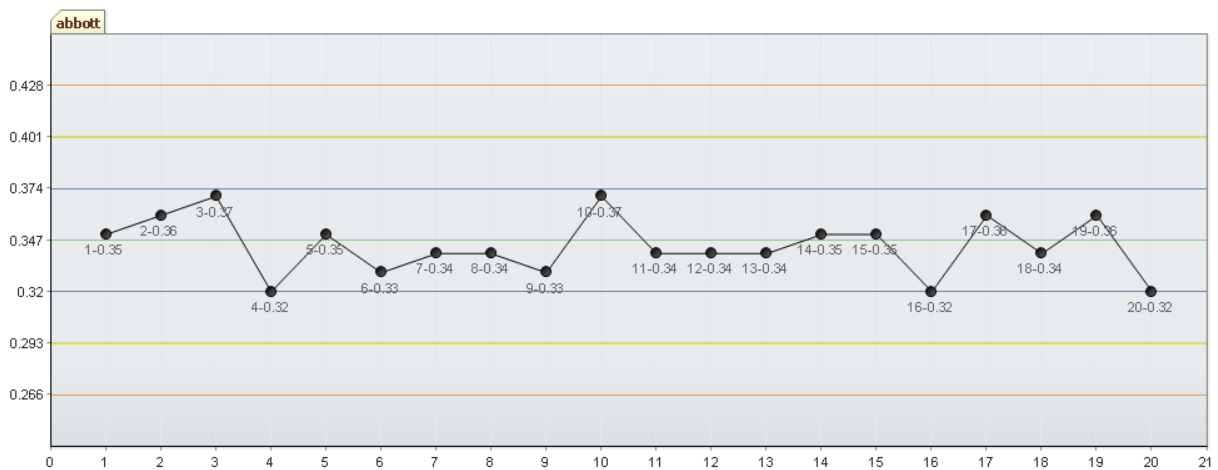

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱	۰,۵۴۵	۶,۵۳	۷,۰۷۵	۷,۶۲	۸,۱۶۵	۸,۷۱	۹,۲۵۵	۹,۸

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷

CV%: 5.522	SD: 0.451	Mean: 8.167
------------	-----------	-------------

