

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۱۴	۶,۱۶۷	۱۵۲,۵۹۹	۱۵۸,۷۶۶	۱۶۴,۹۳۳	۱۷۱,۱	۱۷۷,۲۶۷	۱۸۳,۴۳۴	۱۸۹,۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 2.409	SD: 4.056	Mean: 168.364
------------	-----------	---------------

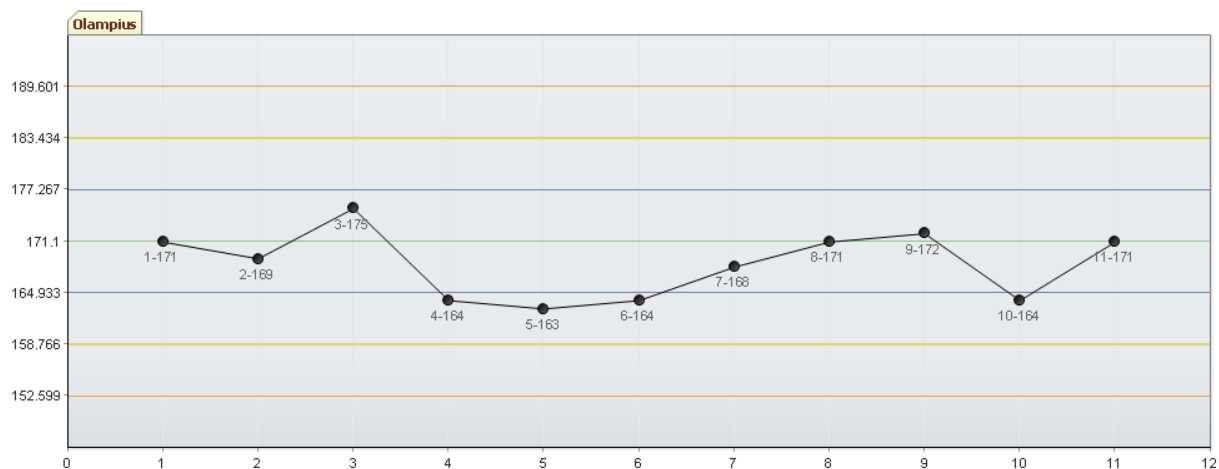

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲,۶۶۷	۳۴,۹۹۹	۳۷,۶۶۶	۴۰,۳۳۳	۴۳	۴۵,۶۶۷	۴۸,۳۳۴	۵۱,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

CV%: 1.391	SD: 0.577	Mean: 41.5
------------	-----------	------------

