

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۷۹۰۴۲۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۰۵	۰,۰۴	۰,۴۷۶	۰,۵۱۶	۰,۵۵۶	۰,۵۹۶	۰,۶۳۶	۰,۶۷۶	۰,۷۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۰,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۰,۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۰,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۰,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۰,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۰,۶۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۰,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۰,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۰,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 4.657	SD: 0.027	Mean: 0.59
------------	-----------	------------

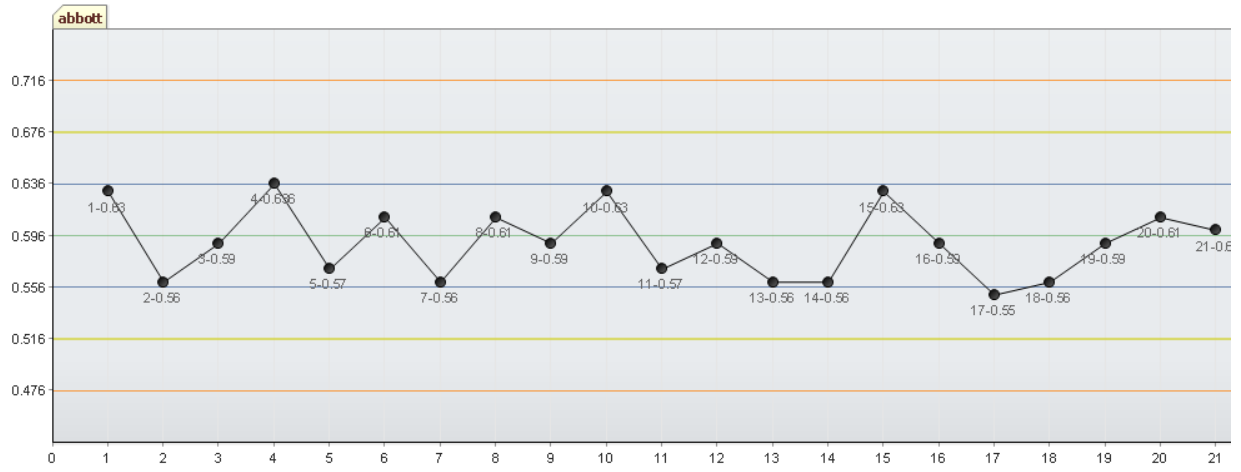

22