

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

سری ساخت : ۳۷۹۰۴۲۳۰

عنوان آزمایش : PSA


عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۱۲۷	۰,۰۳	۰,۵۰۲	۰,۵۳۲	۰,۵۶۲	۰,۵۹۲	۰,۶۲۲	۰,۶۵۲	۰,۶۸۲

مقدار	تاریخ
۰,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۰,۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۰,۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

CV%: 4.687	SD: 0.028	Mean: 0.588
------------	-----------	-------------

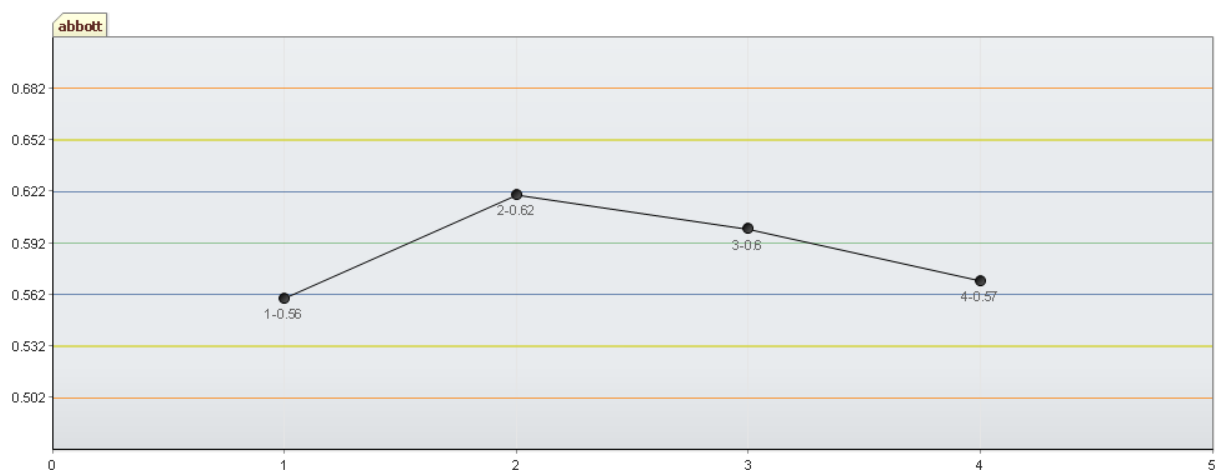

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۶	۰,۰۶۷	۰,۴۵۹	۰,۵۲۶	۰,۵۹۳	۰,۶۶	۰,۷۲۷	۰,۷۹۴	۰,۸۶۱

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۰,۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۰,۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۰,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۰,۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۰,۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۰,۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۰,۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۰,۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰,۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۰,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۰,۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۰,۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۰,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۰,۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۰,۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۰,۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵

CV%: 7.845	SD: 0.05	Mean: 0.642
------------	----------	-------------

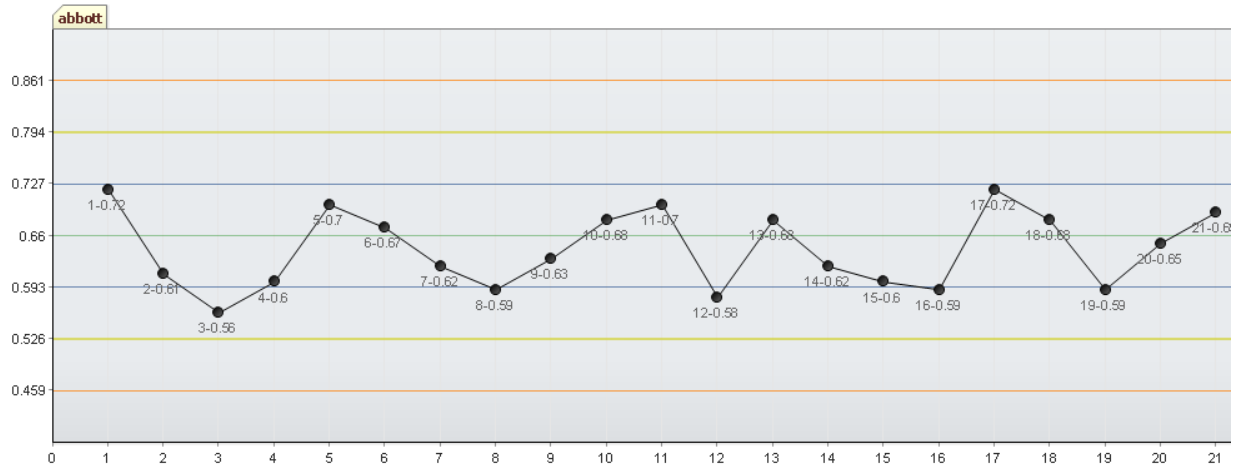

22