

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampus : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ..GN125



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۹۵	۰,۰۴۳	۴,۲۱۱	۴,۲۵۴	۴,۲۹۷	۴,۳۴	۴,۳۸۳	۴,۴۲۶	۴,۴۶۹

مقدار	تاریخ
۴,۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۴,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۴,۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۴,۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۴,۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۴,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۴,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۴,۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴,۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۴,۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۴,۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۴,۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۴,۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹

مقدار	تاریخ
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴,۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۴,۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۴,۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۴,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۴,۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۴,۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹

CV%: 1.222	SD: 0.053	Mean: 4.361
------------	-----------	-------------

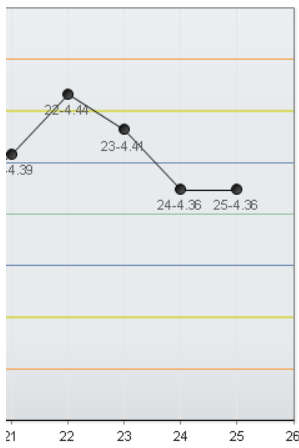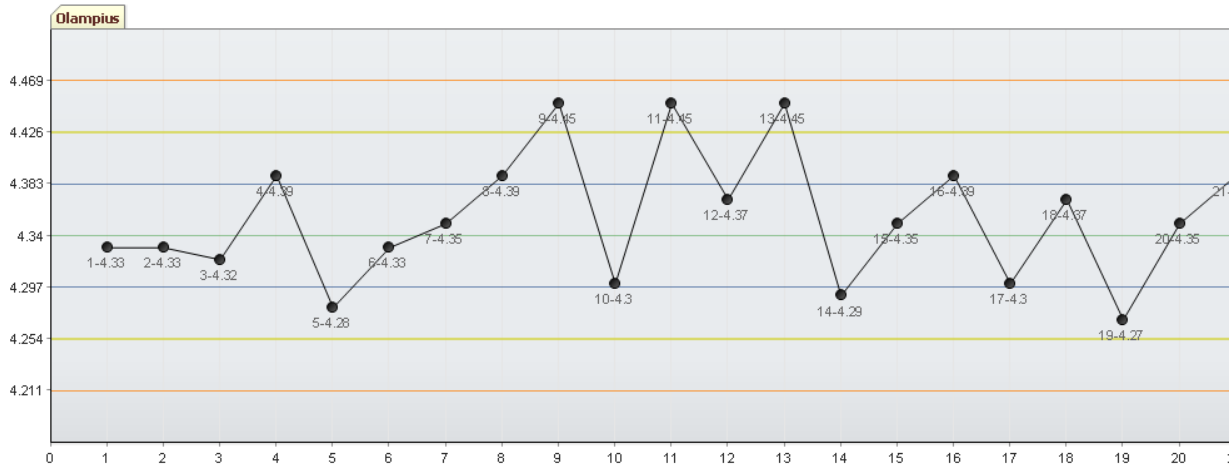

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۲۳۳	۳,۵۰۱	۳,۷۳۴	۳,۹۶۷	۴,۲	۴,۴۳۳	۴,۶۶۶	۴,۸۹۹

مقدار	تاریخ
۴,۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۴,۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۴,۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴,۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۴,۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴,۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳,۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱

CV%: 2.241	SD: 0.091	Mean: 4.064
------------	-----------	-------------

