

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (SGOT (AST  
عنوان دستگاه : Olampius  
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۶۴	۷,۲۳۳	۱۰۴,۱۰۱	۱۱۱,۳۳۴	۱۱۸,۵۶۷	۱۲۵,۸	۱۳۳,۰۳۳	۱۴۰,۲۶۶	۱۴۷,۴۹۹

مقدار	تاریخ
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 6.695	SD: 8.15	Mean: 121.727
------------	----------	---------------

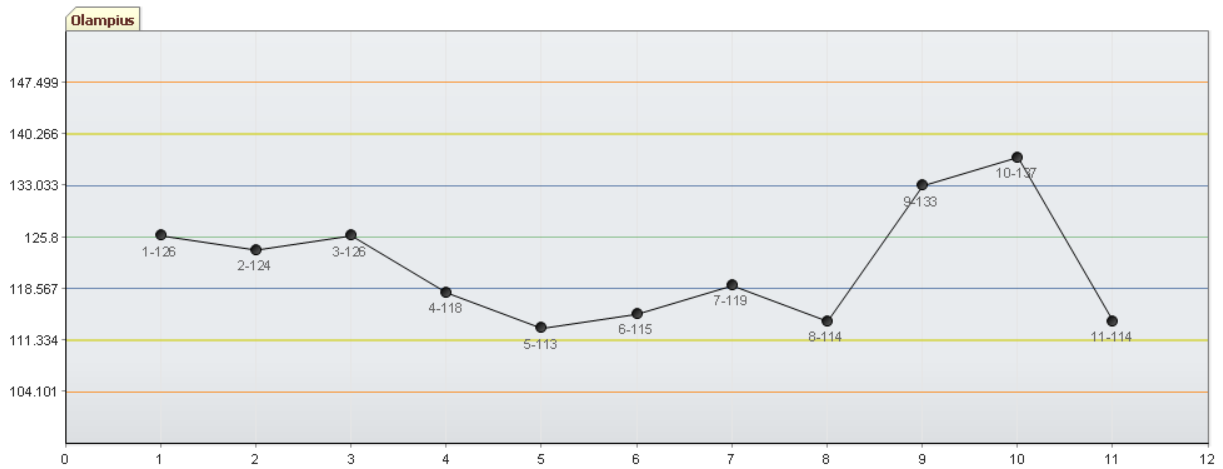

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

(SGOT (AST : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۲,۶۶۷	۳۵,۹۹۹	۳۸,۶۶۶	۴۱,۳۳۳	۴۴	۴۶,۶۶۷	۴۹,۳۳۴	۵۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲

CV%: 1.519	SD: 0.66	Mean: 43.462
------------	----------	--------------

