

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN125..


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۶۲	۷,۰۱۸	۲۶۹,۱۰۱	۲۷۶,۱۱۹	۲۸۳,۱۳۷	۲۹۰,۱۵۵	۲۹۷,۱۷۳	۳۰۴,۱۹۱	۳۱۱,۲۰۹

مقدار	تاریخ
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

CV%: 3.641	SD: 10.637	Mean: 292.176
------------	------------	---------------

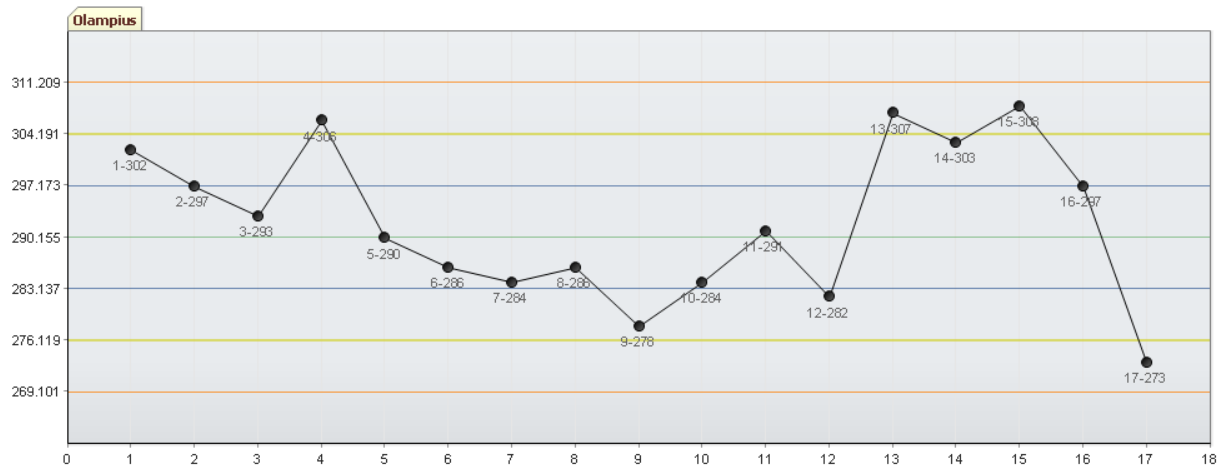

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۱۶,۳۳۳	۲۱۹,۰۰۱	۲۳۵,۳۳۴	۲۵۱,۶۶۷	۲۶۸	۲۸۴,۳۳۳	۳۰۰,۶۶۶	۳۱۶,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸

CV%: 3.58	SD: 9.713	Mean: 271.333
-----------	-----------	---------------

