

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت: GP N025

Albumin serum : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۲۴۴	۰,۰۹۳	۳,۸۴۵	۳,۹۳۸	۴,۰۳۱	۴,۱۲۴	۴,۲۱۷	۴,۳۱	۴,۴۰۳

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.717	SD: 0.071	Mean: 4.105
------------	-----------	-------------

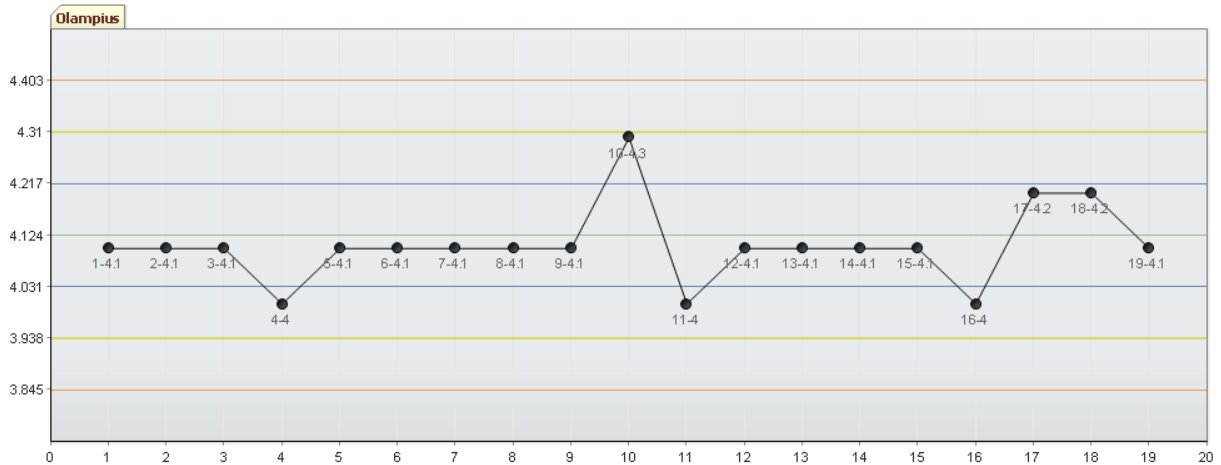

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Albumin serum : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۵۱۷	۰,۱۲۴	۳,۱۵۷	۳,۲۸۱	۳,۴۰۵	۳,۵۲۹	۳,۶۵۳	۳,۷۷۷	۳,۹۰۱

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۳,۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.522	SD: 0.088	Mean: 3.501
------------	-----------	-------------

