

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت : GN225

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۶۳۷	۵,۸۱۷	۲۰۳,۱۱۶	۲۰۸,۹۳۳	۲۱۴,۷۵	۲۲۰,۵۶۷	۲۲۶,۳۸۴	۲۳۲,۲۰۱	۲۳۸,۰۱۸

مقدار	تاریخ
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 2.11	SD: 4.665	Mean: 221.071
-----------	-----------	---------------

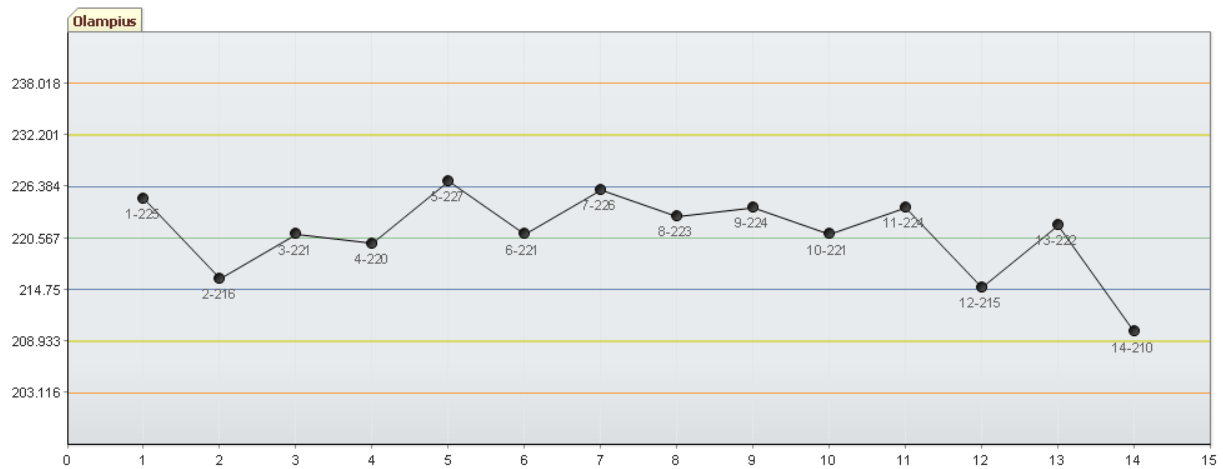

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۱۰,۶۶۷	۱۴۵,۹۹۹	۱۵۶,۶۶۶	۱۶۷,۳۳۳	۱۷۸	۱۸۸,۶۶۷	۱۹۹,۳۳۴	۲۱۰,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 2.452	SD: 4.35	Mean: 177.385
------------	----------	---------------

