

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۰۳	۰,۴۷۹	۱۱,۸۴۶	۱۲,۳۲۵	۱۲,۸۰۴	۱۳,۲۸۳	۱۳,۷۶۲	۱۴,۲۴۱	۱۴,۷۲

مقدار	تاریخ
۱۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۳,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۳,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۳,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 2.425	SD: 0.327	Mean: 13.486
------------	-----------	--------------

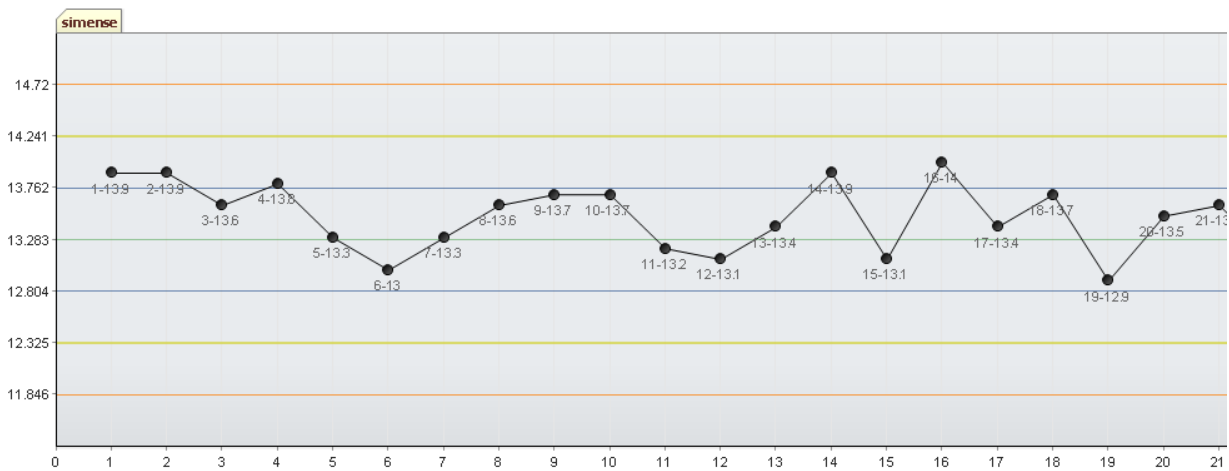

maternal control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ : سری ساخت : MS۸۳۷۴ : Alpha Fetoprotein :
 simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۰۷	۲,۳۴	۴۷,۳۱۳	۴۹,۶۵۳	۵۱,۹۹۳	۵۴,۳۳۳	۵۶,۶۷۳	۵۹,۰۱۳	۶۱,۳۵۳

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
		۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
		۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 3.381	SD: 1.826	Mean: 54
------------	-----------	----------

