

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۵۰۵	۰,۲۲۱	۵,۶۳۸	۵,۸۵۹	۶,۰۸	۶,۳۰۱	۶,۵۲۲	۶,۷۴۳	۶,۹۶۴

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۶,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۶,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.088	SD: 0.068	Mean: 6.274
------------	-----------	-------------

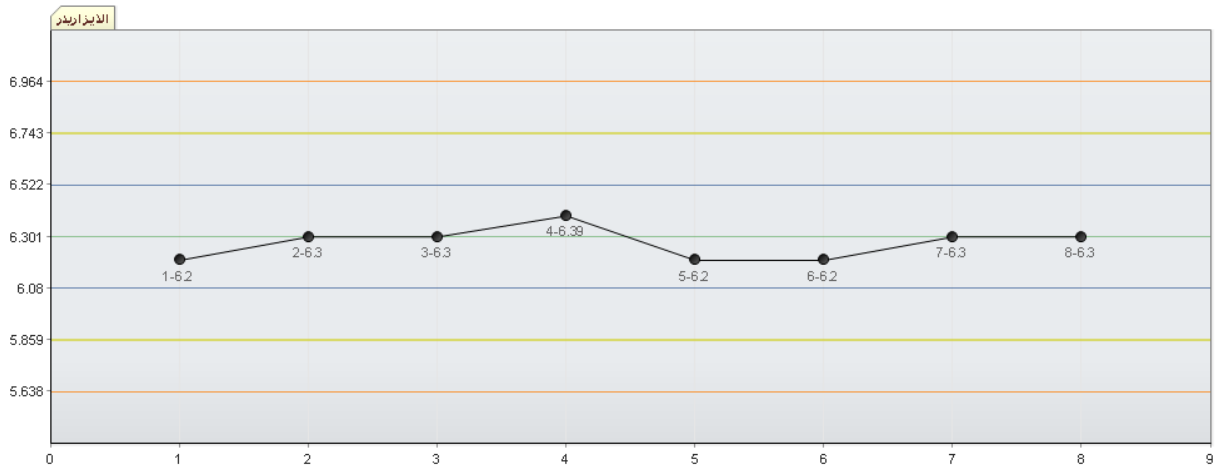

Control Low : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۲۷	۰,۰۱۴	۰,۱۳۲	۰,۱۴۶	۰,۱۶	۰,۱۷۴	۰,۱۸۸	۰,۲۰۲	۰,۲۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۰,۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.99	SD: 0.007	Mean: 0.174
-----------	-----------	-------------

