

Level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت: ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :
هیپتاچی ۹۱۷ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۴۹	۰,۰۶۹	۲,۳۱۳	۲,۳۸۲	۲,۴۵۱	۲,۵۲	۲,۵۸۹	۲,۶۵۸	۲,۷۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲,۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۲,۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲,۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.802	SD: 0.07	Mean: 2.513
------------	----------	-------------

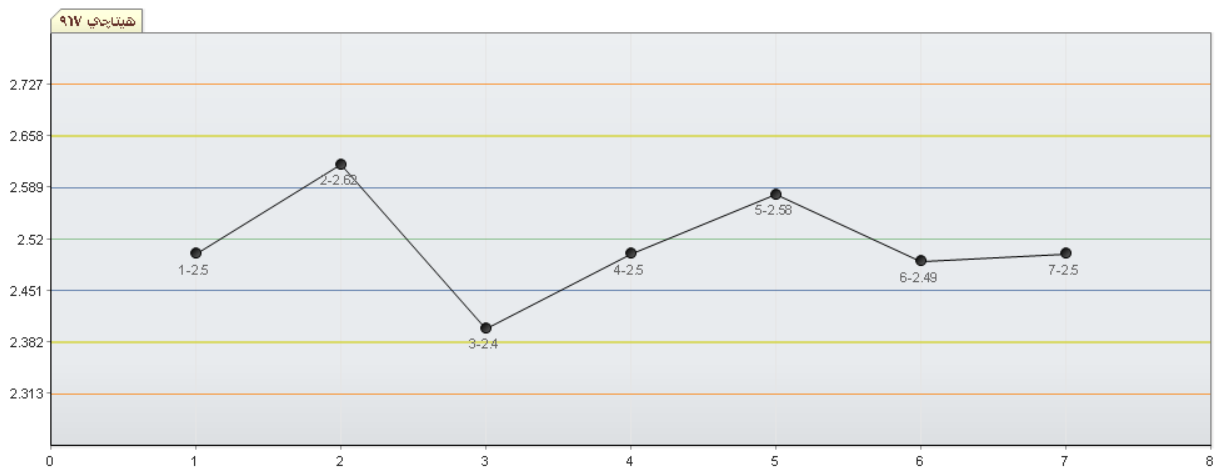

Level II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت: ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :
هیپتاچی ۹۱۷ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۳۵	۰,۱۳۵	۴,۰۴۸	۴,۱۸۳	۴,۳۱۸	۴,۴۵۳	۴,۵۸۸	۴,۷۲۳	۴,۸۵۸

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۴,۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.778	SD: 0.122	Mean: 4.38
------------	-----------	------------

