

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۵	۴,۰۸	۹۹,۵۶	۱۰۳,۶۴	۱۰۷,۷۲	۱۱۱,۸	۱۱۵,۸۸	۱۱۹,۹۶	۱۲۴,۰۴

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 3.281	SD: 3.639	Mean: 110.923
------------	-----------	---------------

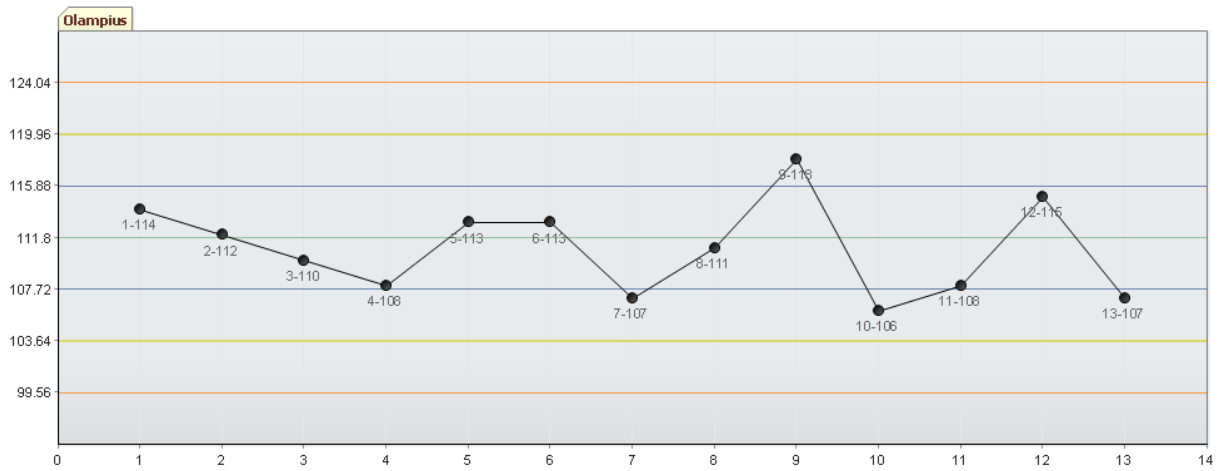

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۲	۲,۳۳۳	۳۴,۰۰۱	۳۶,۳۳۴	۳۸,۶۶۷	۴۱	۴۳,۳۳۳	۴۵,۶۶۶	۴۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.255	SD: 1.329	Mean: 40.833
------------	-----------	--------------

