
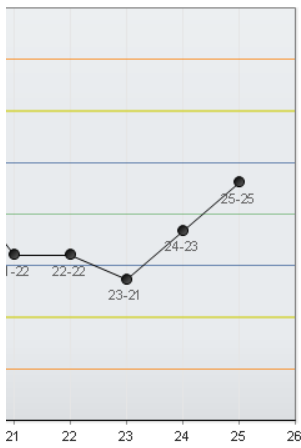


عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸..
عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶	۲,۱۳۳	۱۷,۳۰۱	۱۹,۴۳۴	۲۱,۵۶۷	۲۳,۷	۲۵,۸۳۳	۲۷,۹۶۶	۳۰,۰۹۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
		۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
		۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
CV%: 8.637		SD: 1.955		Mean: 22.64	



Tumormarker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : Roche

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹	۶,۹۱۷	۷۸,۴۹۹	۸۵,۴۱۶	۹۲,۳۳۳	۹۹,۲۵	۱۰۶,۱۶۷	۱۱۳,۰۸۴	۱۲۰,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 5.051	SD: 5.087	Mean: 100.72
------------	-----------	--------------

