

Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۱۶	۰,۲۴۳	۴,۵۴۴	۴,۷۸۷	۵,۰۳	۵,۲۷۳	۵,۵۱۶	۵,۷۵۹	۶,۰۰۲

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.889	SD: 0.155	Mean: 5.364
------------	-----------	-------------

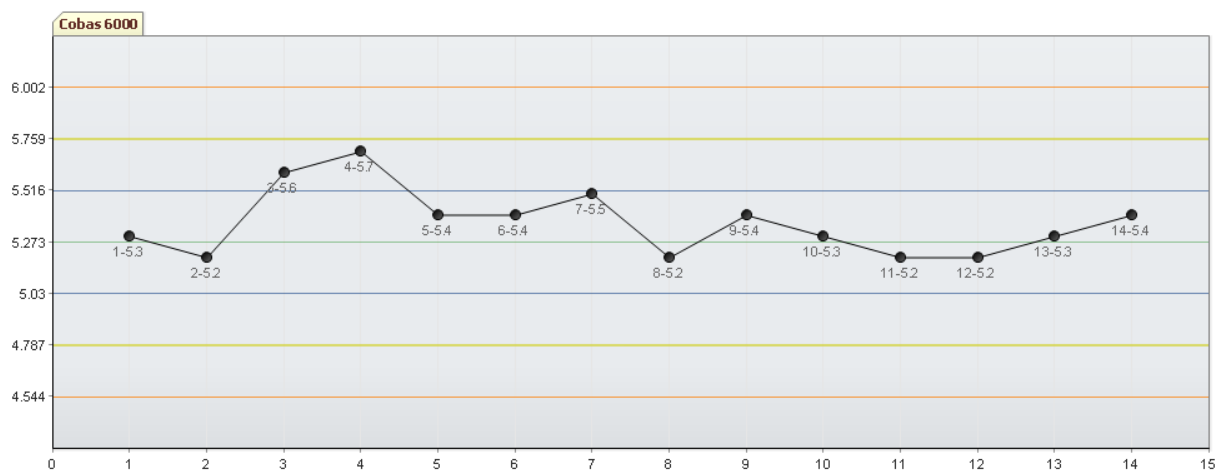

Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۱۶	۲,۱۸۱	۴۶,۴۵۷	۴۸,۶۳۸	۵۰,۸۱۹	۵۳	۵۵,۱۸۱	۵۷,۳۶۲	۵۹,۵۴۳

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.152	SD: 2.238	Mean: 53.893
------------	-----------	--------------

