


عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۱۴۰۴،۰۶،۰۸
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۲۳	۰,۲۳	۸,۴۳۵	۸,۶۶۵	۸,۸۹۵	۹,۱۲۵	۹,۳۵۵	۹,۵۸۵	۹,۸۱۵

مقدار	تاریخ
۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱

CV%: 2.318	SD: 0.212	Mean: 9.15
------------	-----------	------------

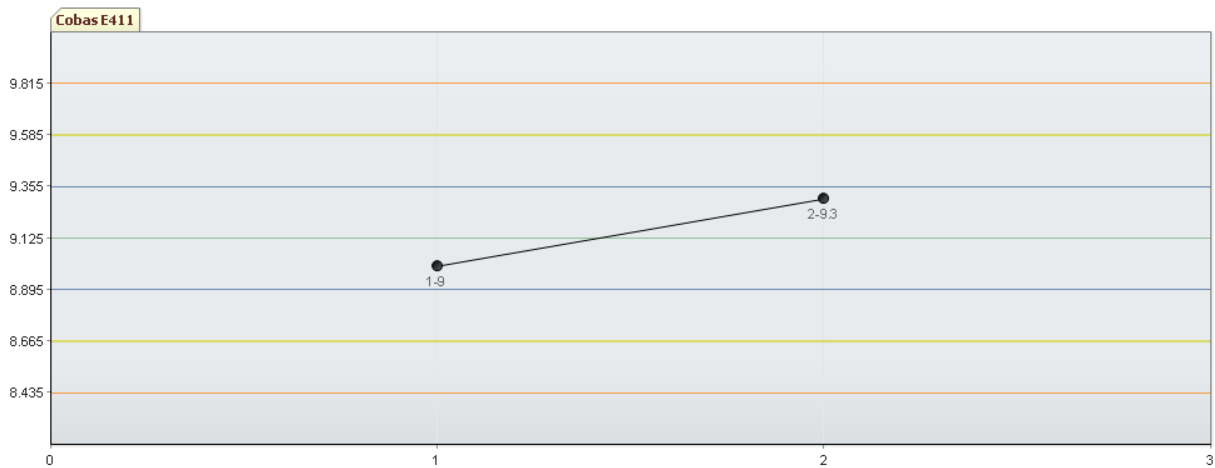

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۱۴۰۴،۱۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰،۰۹۶	۲،۱۶۱	۲،۲۵۷	۲،۳۵۳	۲،۴۴۹	۲،۵۴۵	۲،۶۴۱	۲،۷۳۷

مقدار	تاریخ
۲،۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲،۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲،۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲،۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲،۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۲،۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲،۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲،۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

CV%: 3.003	SD: 0.073	Mean: 2.432
------------	-----------	-------------

