

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : MS۸۱۴۴


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۸۲	۰,۰۲۵	۰,۴۷۷	۰,۵۰۲	۰,۵۲۷	۰,۵۵۲	۰,۵۷۷	۰,۶۰۲	۰,۶۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۰,۵۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۰,۵۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰,۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۰,۵۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۰,۵۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۰,۵۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۰,۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۰,۵۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۰,۵۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 5.777	SD: 0.032	Mean: 0.559
------------	-----------	-------------

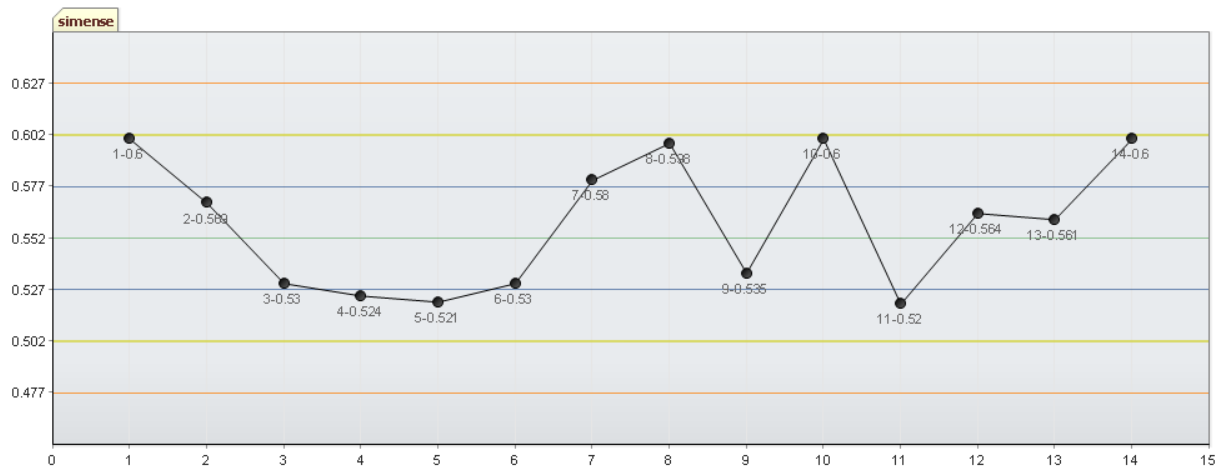

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
سری ساخت : MS۸۳۷۴


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۰۴	۰,۰۷۸	۱,۸۷۸	۱,۹۵۶	۲,۰۳۴	۲,۱۱۲	۲,۱۹	۲,۲۶۸	۲,۳۴۶

مقدار	تاریخ
۲,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۲,۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۲,۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶

CV%: 2.923	SD: 0.063	Mean: 2.15
------------	-----------	------------

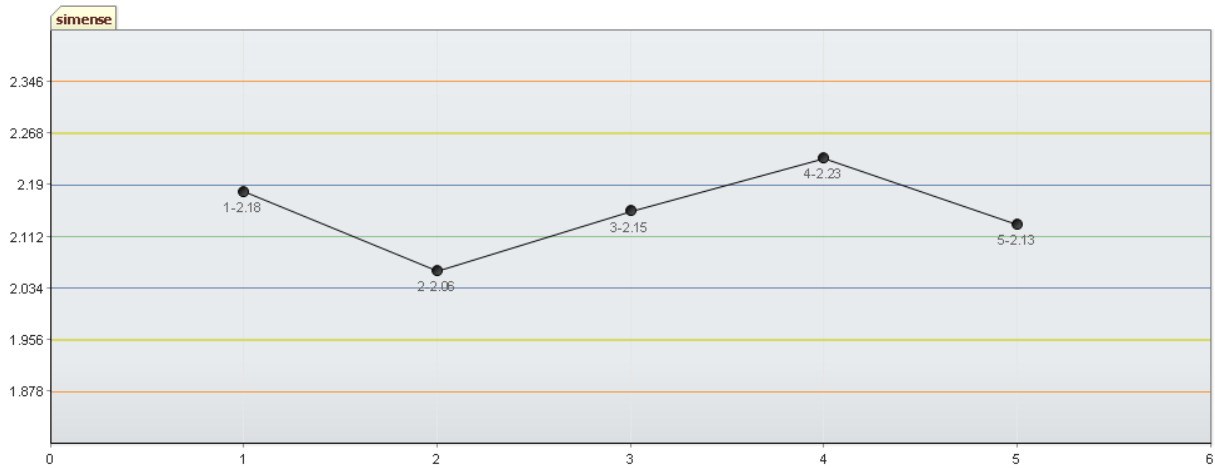

Randox III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : MS۸۱۵۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۹	۰,۳۷۳	۳,۳۵۱	۳,۷۲۴	۴,۰۹۷	۴,۴۷	۴,۸۴۳	۵,۲۱۶	۵,۵۸۹

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 5.594	SD: 0.258	Mean: 4.611
------------	-----------	-------------

