

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۴


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۳۶	۰,۲۳۵	۳,۱۹۵	۳,۴۳	۳,۶۶۵	۳,۹	۴,۱۳۵	۴,۳۷	۴,۶۰۵

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.814	SD: 0.222	Mean: 3.824
------------	-----------	-------------

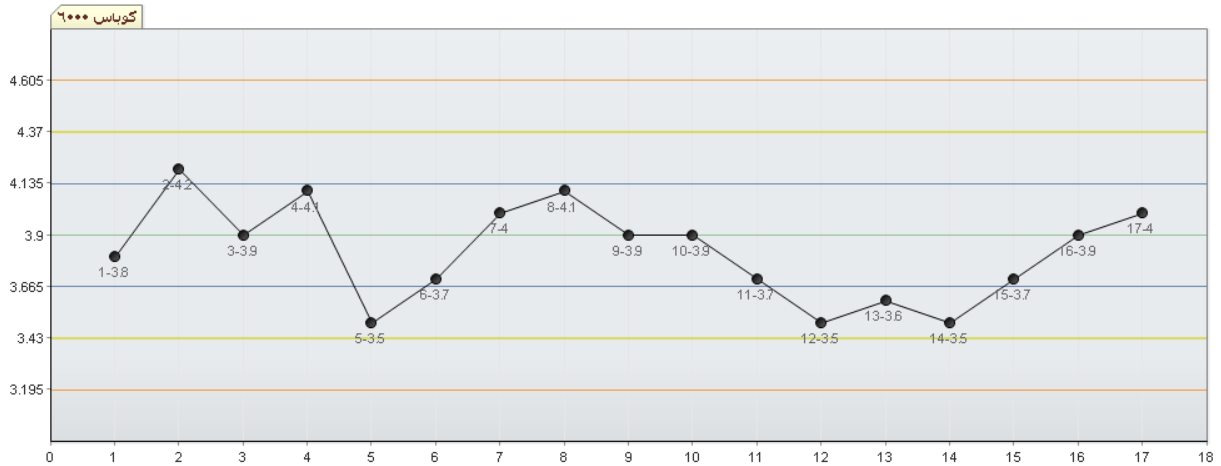

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :  
سری ساخت: ۵۸۹۹۶۶ : عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۰۳۷	۰,۶۳۲	۱۳,۷۶۲	۱۴,۳۹۴	۱۵,۰۲۶	۱۵,۶۵۸	۱۶,۲۹	۱۶,۹۲۲	۱۷,۵۵۴

مقدار	تاریخ
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۴,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۴,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.064	SD: 0.624	Mean: 15.365
------------	-----------	--------------

