

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۴


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۳۲	۰,۱۶۷	۳,۲۷۴	۳,۴۴۱	۳,۶۰۸	۳,۷۷۵	۳,۹۴۲	۴,۱۰۹	۴,۲۷۶

مقدار	تاریخ
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.005	SD: 0.151	Mean: 3.758
------------	-----------	-------------

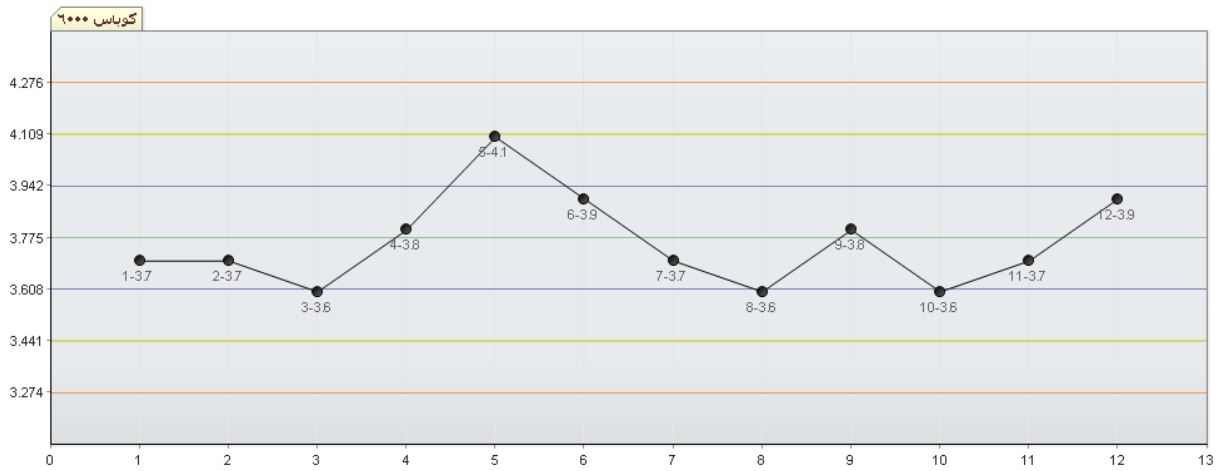

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۶ : عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۹۸	۰,۵۷۵	۱۳,۴۲۱	۱۳,۹۹۶	۱۴,۵۷۱	۱۵,۱۴۶	۱۵,۷۲۱	۱۶,۲۹۶	۱۶,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.902	SD: 0.434	Mean: 14.95
------------	-----------	-------------

