

عنوان کنترل : کنترول Hight  
شروع کنترول: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

سری ساخت : T55L2D5

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الایزایدر


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۲۲	۰,۵۵۲	۱۸,۶۳۵	۱۹,۱۸۷	۱۹,۷۳۹	۲۰,۲۹۱	۲۰,۸۴۳	۲۱,۳۹۵	۲۱,۹۴۷

مقدار	تاریخ
۲۰,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۹,۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۹,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۹,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۰,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۰,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۹,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 2.193	SD: 0.441	Mean: 20.1
------------	-----------	------------

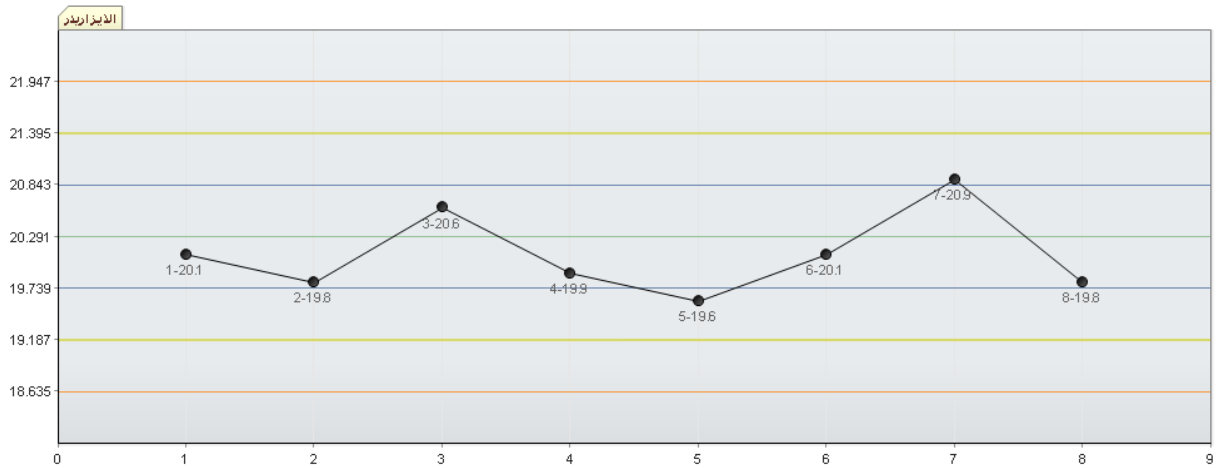

عنوان کنترل : کنترل Low  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

سری ساخت : T55L2D5

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۱۱۶	۰,۰۸۹	۰,۸۲۹	۰,۹۱۸	۱,۰۰۷	۱,۰۹۶	۱,۱۸۵	۱,۲۷۴	۱,۳۶۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱,۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰,۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 7.039	SD: 0.076	Mean: 1.074
------------	-----------	-------------

