

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

سری ساخت : GP425

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۷۵	۲,۳۷۴	۶۵,۳۷۸	۶۷,۷۵۲	۷۰,۱۲۶	۷۲,۵	۷۴,۸۷۴	۷۷,۲۴۸	۷۹,۶۲۲

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 3.261	SD: 2.38	Mean: 73
------------	----------	----------

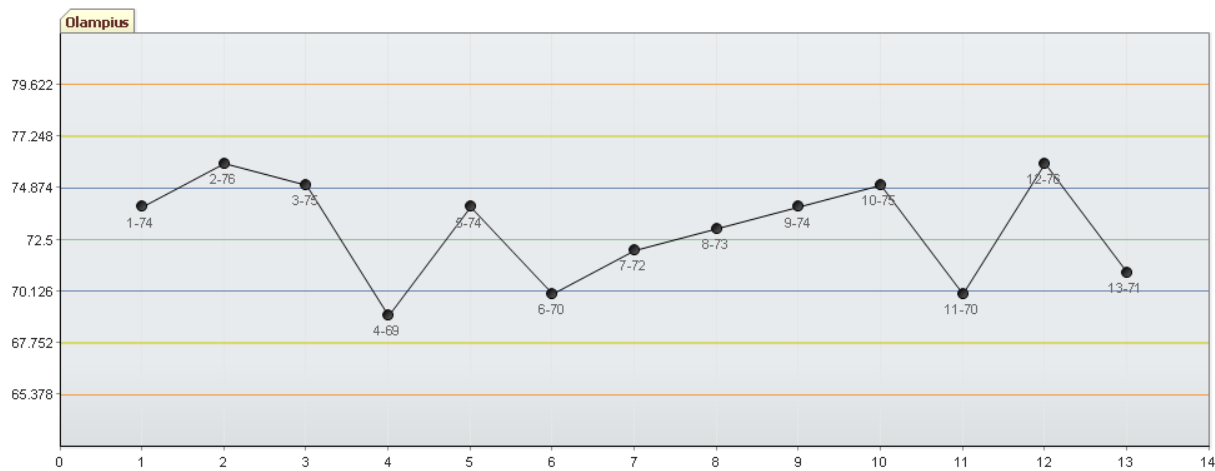

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۰۲	۵,۳۳۳	۵۹,۰۰۱	۶۴,۳۳۴	۶۹,۶۶۷	۷۵	۸۰,۳۳۳	۸۵,۶۶۶	۹۰,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 1.994	SD: 1.472	Mean: 73.833
------------	-----------	--------------

