

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

IRON : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۴۵	۵,۶۲	۱۸۷,۸۷۳	۱۹۳,۴۹۳	۱۹۹,۱۱۳	۲۰۴,۷۳۳	۲۱۰,۳۵۳	۲۱۵,۹۷۳	۲۲۱,۵۹۳

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.18	SD: 4.477	Mean: 205.4
-----------	-----------	-------------

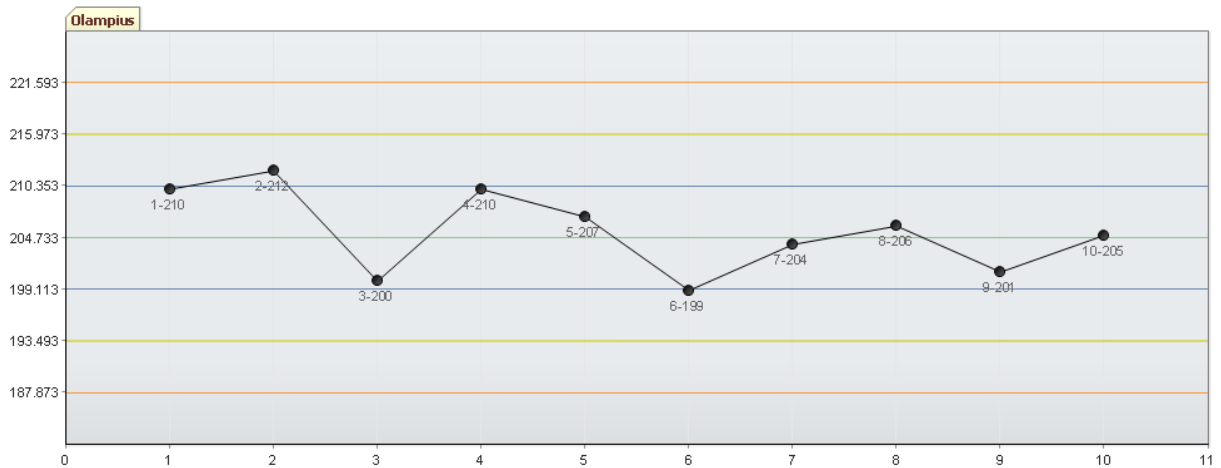

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

IRON : عنوان آزمایش :
Olympus : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۵	۵,۳۳۳	۹۸,۰۰۱	۱۰۳,۳۳۴	۱۰۸,۶۶۷	۱۱۴	۱۱۹,۳۳۳	۱۲۴,۶۶۶	۱۲۹,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.229	SD: 3.724	Mean: 115.333
------------	-----------	---------------

