

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۷۶	۲۷,۸۵۹	۶۹۵,۴۹	۷۲۳,۳۴۹	۷۵۱,۲۰۸	۷۷۹,۰۶۷	۸۰۶,۹۲۶	۸۳۴,۷۸۵	۸۶۲,۶۴۴

مقدار	تاریخ
۷۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۸۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۸۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۷۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۷۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۷۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۷۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 3.802	SD: 30.06	Mean: 790.571
------------	-----------	---------------

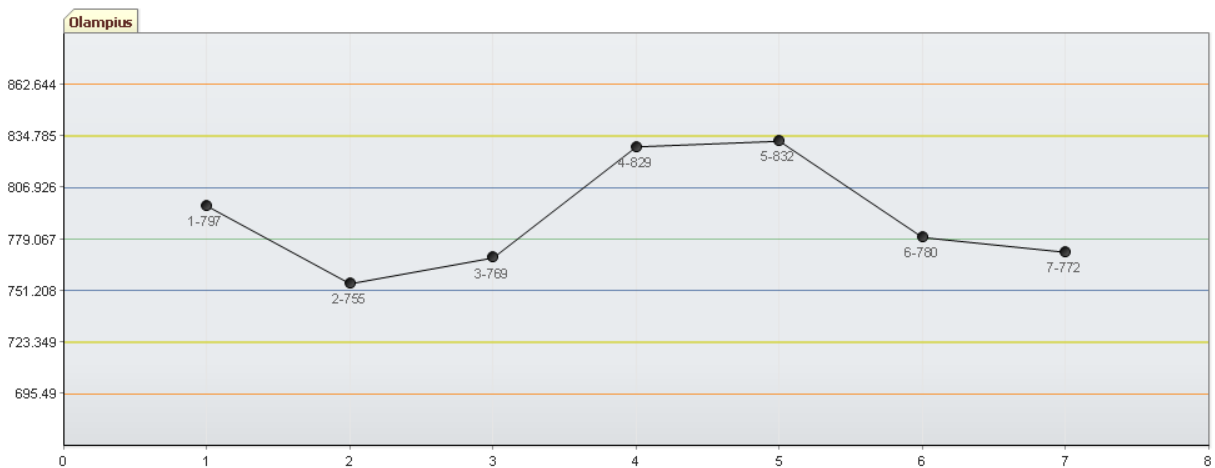

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲۰,۳۳۳	۲۵۵,۰۰۱	۲۷۵,۳۳۴	۲۹۵,۶۶۷	۳۱۶	۳۳۶,۳۳۳	۳۵۶,۶۶۶	۳۷۶,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۳۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۳۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۳۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۳۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۳۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 3.952	SD: 12.965	Mean: 328.083
------------	------------	---------------

