

عنوان کنترل : RTI TEB I  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

عنوان آزمایش : Lithium  
عنوان دستگاه : مدیکا  
سری ساخت : RTC09340


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۴۶	۰,۰۱۴	۰,۹۴۱	۰,۹۵۵	۰,۹۶۹	۰,۹۸۳	۰,۹۹۷	۱,۰۱۱	۱,۰۲۵

مقدار	تاریخ
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۰,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 1.109	SD: 0.011	Mean: 0.981
------------	-----------	-------------

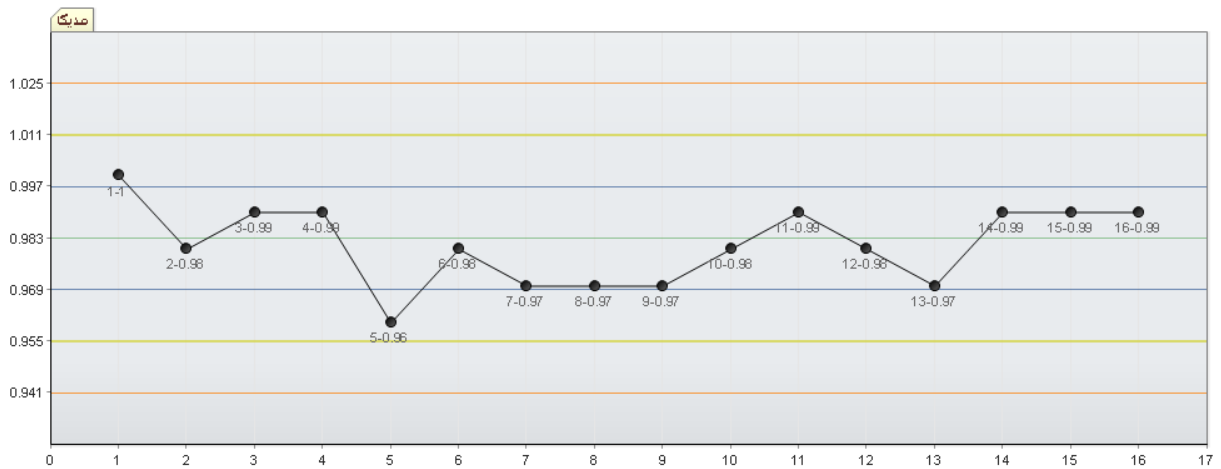

RTI TEB III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Lithium : عنوان آزمایش :  
مدیکا : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۰۵	۰,۹۵	۱	۱,۰۵	۱,۱	۱,۱۵	۱,۲	۱,۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۱,۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

CV%: 2.496	SD: 0.028	Mean: 1.106
------------	-----------	-------------

