

Maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۷۸۰۲۲


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۸۶	۰,۲۱۴	۴,۴۸۱	۴,۶۹۵	۴,۹۰۹	۵,۱۲۳	۵,۳۳۷	۵,۵۵۱	۵,۷۶۵

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۴,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۵,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 4.227	SD: 0.217	Mean: 5.143
------------	-----------	-------------

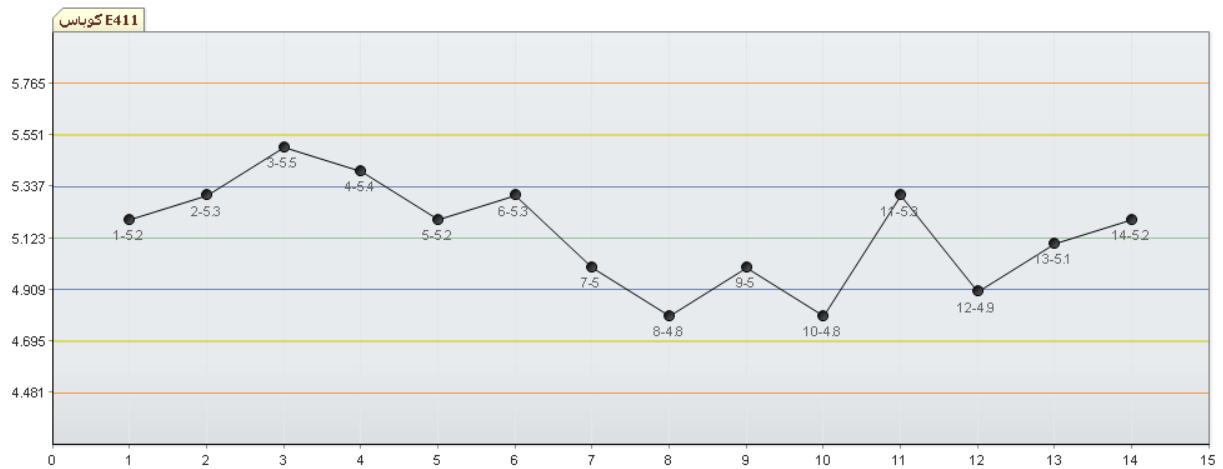

Maternal control III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰ : عنوان دستگاه :
کوباس E411

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۶۷	۰,۰۰۹	۰,۲۲۱	۰,۲۳	۰,۲۳۹	۰,۲۴۸	۰,۲۵۷	۰,۲۶۶	۰,۲۷۵

مقدار	تاریخ
۰,۲۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۰,۲۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۰,۲۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۰,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۰,۲۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۰,۲۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۰,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۲۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۲۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۰,۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۰,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۰,۲۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۰,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.874	SD: 0.01	Mean: 0.25
------------	----------	------------

