

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۵۵	۰,۱۳۸	۳,۶۸۹	۳,۸۲۷	۳,۹۶۵	۴,۱۰۳	۴,۲۴۱	۴,۳۷۹	۴,۵۱۷

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۳,۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۳,۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳,۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴,۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 1.937	SD: 0.078	Mean: 4.04
------------	-----------	------------

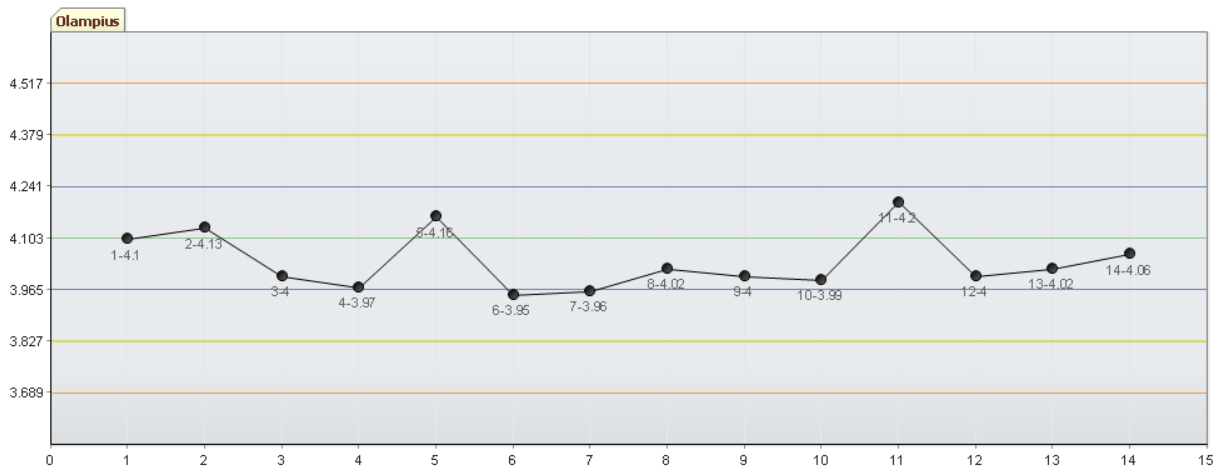

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۲۶۷	۳,۴۹۹	۳,۷۶۶	۴,۰۳۳	۴,۳	۴,۵۶۷	۴,۸۳۴	۵,۱۰۱

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۴,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴,۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۴,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۴,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴,۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 5.472	SD: 0.234	Mean: 4.281
------------	-----------	-------------

