

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸۶۱	۰,۳۸۷	۶,۸۱	۷,۱۹۷	۷,۵۸۴	۷,۹۷۱	۸,۳۵۸	۸,۷۴۵	۹,۱۳۲

مقدار	تاریخ
۷,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۸,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۸,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۸,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۷,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۸,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۸,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۷,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.772	SD: 0.385	Mean: 8.071
------------	-----------	-------------

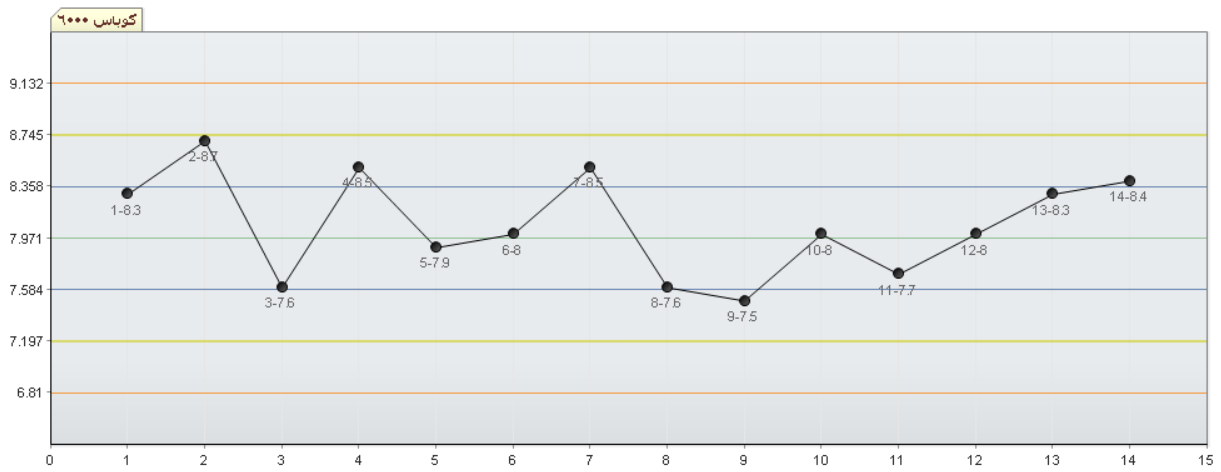

عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۳۲	۱,۲۶۲	۱۶,۱۸۱	۱۷,۴۴۳	۱۸,۷۰۵	۱۹,۹۶۷	۲۱,۲۲۹	۲۲,۴۹۱	۲۳,۷۵۳

مقدار	تاریخ
۱۸,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 5.99	SD: 1.211	Mean: 20.207
-----------	-----------	--------------

