

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN 325


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۱۸	۱,۳۱۳	۴۱,۰۶۱	۴۲,۳۷۴	۴۳,۶۸۷	۴۵	۴۶,۳۱۳	۴۷,۶۲۶	۴۸,۹۳۹

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.55	SD: 1.144	Mean: 44.846
-----------	-----------	--------------

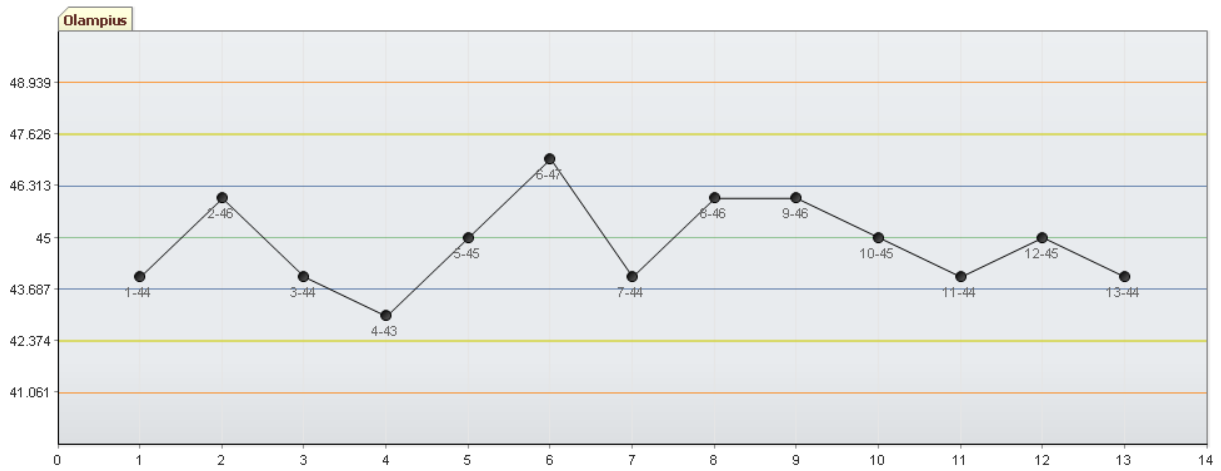

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۵	۳	۳۷	۴۰	۴۳	۴۶	۴۹	۵۲	۵۵

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 5.129	SD: 2.317	Mean: 45.167
------------	-----------	--------------

