

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : SGPT (ALT) : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۲۳	۵,۵۲۹	۷۶,۷۷۳	۸۲,۳۰۲	۸۷,۸۳۱	۹۳,۳۶	۹۸,۸۸۹	۱۰۴,۴۱۸	۱۰۹,۹۴۷

مقدار	تاریخ
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 4.804	SD: 4.475	Mean: 93.158
------------	-----------	--------------

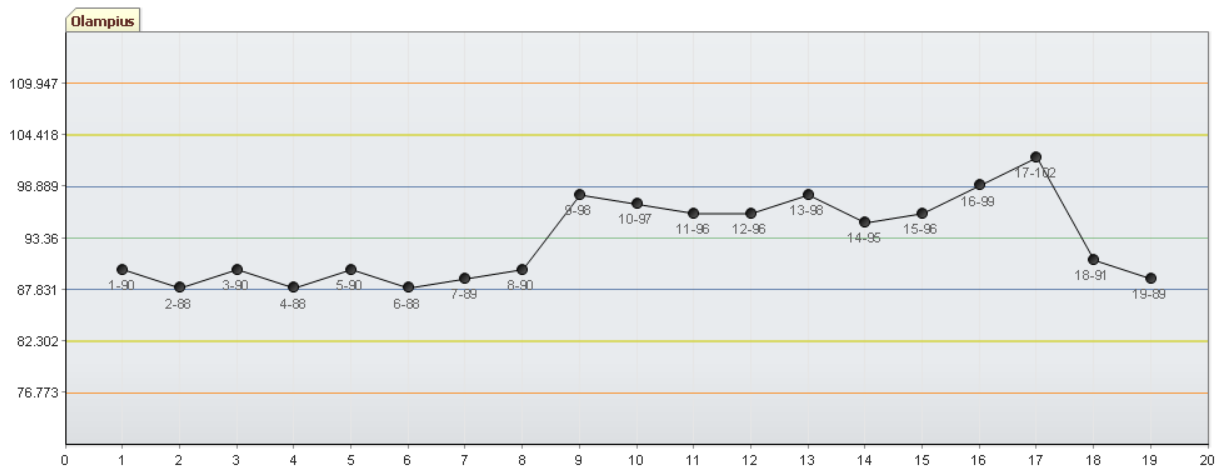

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۱۴	۲,۰۸	۳۹,۸۴	۴۱,۹۲	۴۴	۴۶,۰۸	۴۸,۱۶	۵۰,۲۴	۵۲,۳۲

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 4.266	SD: 1.978	Mean: 46.368
------------	-----------	--------------

