

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal HIGH
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۲۷	۱۱,۹۴۸	۳۱۲,۷۶۳	۳۲۴,۷۱۱	۳۳۶,۶۵۹	۳۴۸,۶۰۷	۳۶۰,۵۵۵	۳۷۲,۵۰۳	۳۸۴,۴۵۱

مقدار	تاریخ
۳۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۳۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 3.226	SD: 11.411	Mean: 353.75
------------	------------	--------------

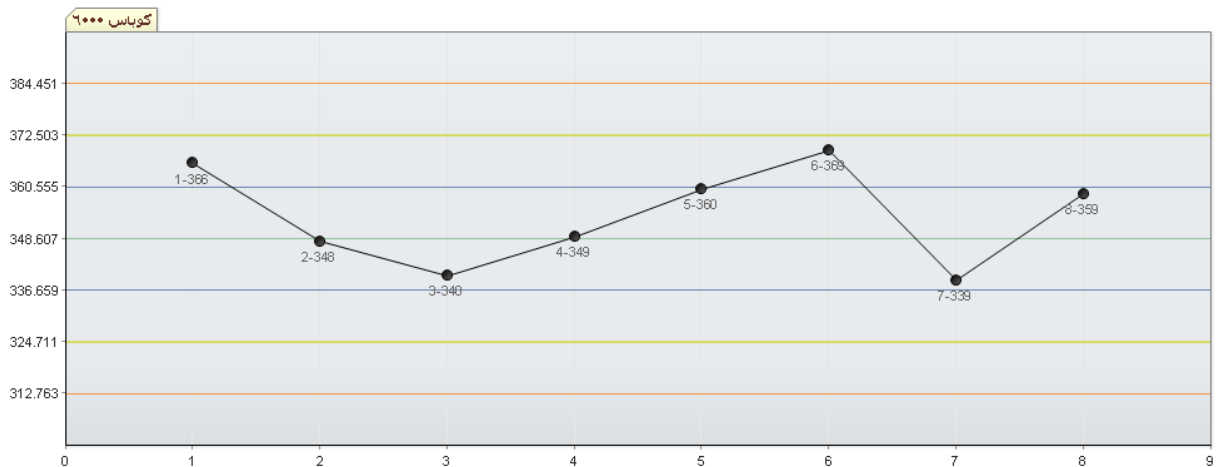

عنوان آزمایش : عنوان آزمایش : عنوان آزمایش :
 عنوان دستگاه : عنوان دستگاه : عنوان دستگاه :
 کوباس ۶۰۰۰ سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹ شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
 عنوان کنترل : universal LOW

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۷	۶,۸۶۵	۱۲۹,۶۱۸	۱۳۶,۴۸۳	۱۴۳,۳۴۸	۱۵۰,۲۱۳	۱۵۷,۰۷۸	۱۶۳,۹۴۳	۱۷۰,۸۰۸

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 4.26	SD: 6.278	Mean: 147.375
-----------	-----------	---------------

