

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۲۵	۱۲,۷۷۵	۲۵۰,۳۴۲	۲۶۳,۱۱۷	۲۷۵,۸۹۲	۲۸۸,۶۶۷	۳۰۱,۴۴۲	۳۱۴,۲۱۷	۳۲۶,۹۹۲

مقدار	تاریخ
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 4.285	SD: 12.473	Mean: 291.077
------------	------------	---------------

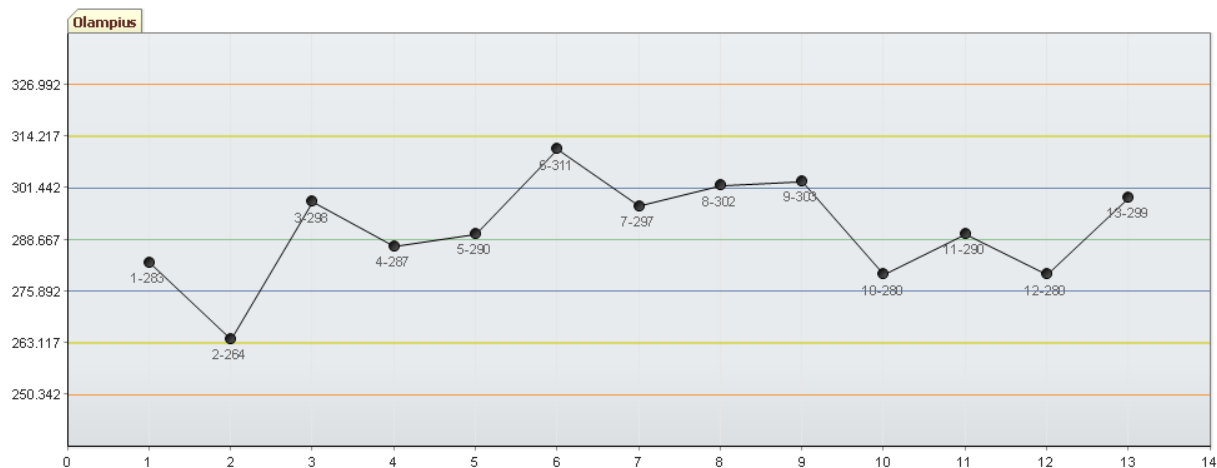

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

TIBC : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۱	۱۷	۱۹۱	۲۰۸	۲۲۵	۲۴۲	۲۵۹	۲۷۶	۲۹۳

مقدار	تاریخ
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.281	SD: 8.017	Mean: 244.333
------------	-----------	---------------

