

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

TSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۵۸	۰,۰۵۲	۱,۳۰۳	۱,۳۵۵	۱,۴۰۷	۱,۴۵۹	۱,۵۱۱	۱,۵۶۳	۱,۶۱۵

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱,۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱,۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱,۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱,۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.968	SD: 0.043	Mean: 1.439
------------	-----------	-------------

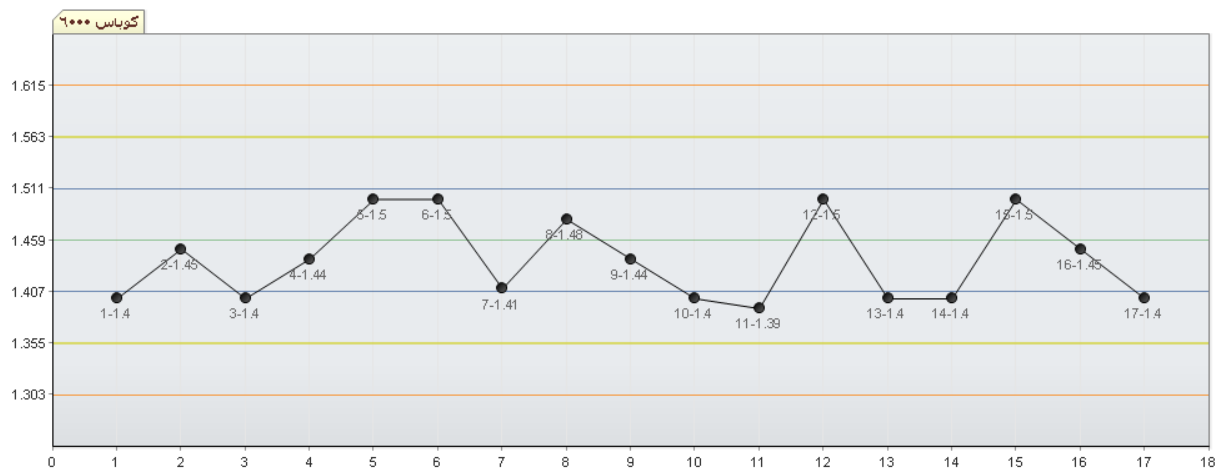

عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹-

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۸۲	۰,۳۳۱	۸,۲۵۳	۸,۵۸۴	۸,۹۱۵	۹,۲۴۶	۹,۵۷۷	۹,۹۰۸	۱۰,۲۳۹

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۸,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۹,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۸,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۹,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۹,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۹,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۸,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۹,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۹,۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.196	SD: 0.293	Mean: 9.173
------------	-----------	-------------

